

Numero del servizio clienti
per le nostre applicazioni digitali



0800 102 102*

(numero verde)

Dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00.

* Le chiamate al servizio clienti potrebbero essere registrate e memorizzate da Abbott su server situati nella UE. Utilizzando il numero 0800 102 102 l'utente dichiara di acconsentire a questa procedura. Servizio gratuito dalla rete fissa e dalla rete mobile svizzera a livello nazionale.

Tabella di conversione dei valori del glucosio

mg/dL	mmol/L	mg/dL	mmol/L	mg/dL	mmol/L
20	1.1	76	4.2	150	8.3
22	1.2	78	4.3	155	8.6
24	1.3	80	4.4	160	8.9
26	1.4	82	4.6	165	9.2
28	1.6	84	4.7	170	9.4
30	1.7	86	4.8	175	9.7
32	1.8	88	4.9	180	10.0
34	1.9	90	5.0	185	10.3
36	2.0	92	5.1	190	10.5
38	2.1	94	5.2	195	10.8
40	2.2	96	5.3	200	11.1
42	2.3	98	5.4	225	12.5
44	2.4	100	5.6	250	13.9
46	2.6	102	5.7	275	15.3
48	2.7	104	5.8	300	16.7
50	2.8	106	5.9	325	18.0
52	2.9	108	6.0	350	19.4
54	3.0	110	6.1	375	20.8
56	3.1	112	6.2	400	22.2
58	3.2	114	6.3	425	23.6
60	3.3	116	6.4	450	25.0
62	3.4	118	6.6	475	26.4
64	3.6	120	6.7	500	27.8
66	3.7	125	6.9	525	29.1
68	3.8	130	7.2	550	30.5
70	3.9	135	7.5	575	31.9
72	4.0	140	7.8	600	33.3
74	4.1	145	8.0		

18,016 x mmol/L = mg/dL | 0,0555 x mg/dL = mmol/L



**FreeStyle
Libre 2
PLUS**



FreeStyle Libre 2

Un aiuto per convivere con il diabete
e fare le Sue scelte.


Abbott

Indice

Il sistema FreeStyle Libre 2

Il sistema FreeStyle Libre 2 – tutte le sue potenzialità	4
L'ecosistema di FreeStyle Libre 2	5
Differenza tra misurazione della glicemia e del glucosio tissutale	6
Ritardo temporale: valore glicemico e del glucosio tissutale	8

Passo per passo: applicazione del sensore e avvio

Prima di applicare il sensore	10
Consigli per una migliore adesione del sensore	11
Ausili per l'adesione del sensore	12
Consigli per indossare il sensore	13
Scaricare l'app	14
Applicazione del sensore	17
Avvio del sensore	20
Indicazioni per indossare il sensore	22
Rimozione del sensore	24
Smaltimento	25

App FreeStyle LibreLink e lettore: i miei dati del glucosio

Cosa offre l'app FreeStyle LibreLink	27
Sistema a semaforo	29
Tempo nel range target	30
Freccia della tendenza	32
Report	35
Allarmi	36
Confronto tra app e lettore	44
Ecosistema digitale	46
Lettore	48
Selezione del dispositivo collegato	52

LibreView: dati del glucosio per me e il mio team di diabetologia

LibreView	56
Profilo di glucosio ambulatoriale (AGP)	59
Condividere i dati del glucosio con il team di diabetologia	63
Passo per passo: condividere i dati del glucosio	64

LibreLinkUp: condividere i dati del glucosio con familiari e amici

L'app LibreLinkUp	67
-------------------	----

Informazioni importanti

Acquisto di prodotti FreeStyle Libre	68
Assunzione dei costi da parte della cassa malati	69
Servizio clienti	70
Reclami su prodotti	71
I miei dati più importanti	73



Sensore

App

Lettore

Il sistema di misurazione FreeStyle Libre 2
è formato dal sensore circolare
FreeStyle Libre 2 Plus e dall'app¹ gratuita
FreeStyle LibreLink o dal lettore a
pagamento² FreeStyle Libre 2.

Il sistema FreeStyle Libre 2 – tutte le sue potenzialità:

Il sistema FreeStyle Libre 2 è formato dal sensore FreeStyle Libre 2 Plus e dall'app¹ gratuita FreeStyle LibreLink o, in alternativa, dal lettore² a pagamento FreeStyle Libre 2. Il sensore misura e salva continuamente i valori del glucosio, i quali vengono trasmessi direttamente all'app FreeStyle LibreLink sullo smartphone¹ (oppure, in alternativa, sul lettore) e possono essere letti in qualsiasi momento³ con una scansione di 1 secondo.



Sensore FreeStyle Libre 2 Plus

- ✓ **Discreto** – grande quanto una moneta da 2 franchi svizzeri.
- ✓ Può essere indossato fino a **15 giorni**, sia di giorno che di notte^{5,6,9}.
- ✓ Il sensore **misura e salva automaticamente** i dati del glucosio fino a 8 ore.³⁵
- ✓ Il sensore è **impermeabile** e può essere indossato durante il bagno, la doccia e il nuoto.⁷
- ✓ **Sensore calibrato in fabbrica** – non occorrono calibrazioni⁸ con la puntura del dito²⁰.
- ✓ **Elevata precisione di misurazione** già dal primo giorno d'uso.⁸
- ✓ Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus è omologato per il **trasferimento dei dati di insulina** ottenuti dalle smartpen¹⁰.


App FreeStyle LibreLink

- ✓ Visualizzazione dei **valori del glucosio precisi al minuto** direttamente sullo smartphone e possibilità di leggerli in qualsiasi momento con una scansione di 1 secondo.
- ✓ **1'440 valori del glucosio al giorno**, precisi al minuto, disponibili dando un'occhiata allo smartphone.
- ✓ Ricevimento di **allarmi¹² opzionali** tramite notifica push.
- ✓ **Connessione dati diretta** a LibreView¹⁴⁻¹⁶ e LibreLinkUp¹⁶⁻¹⁹.
- ✓ **Emissione vocale** opzionale.

Scarichi ora gratuitamente l'app **FreeStyle LibreLink**!



L'ecosistema di FreeStyle Libre 2

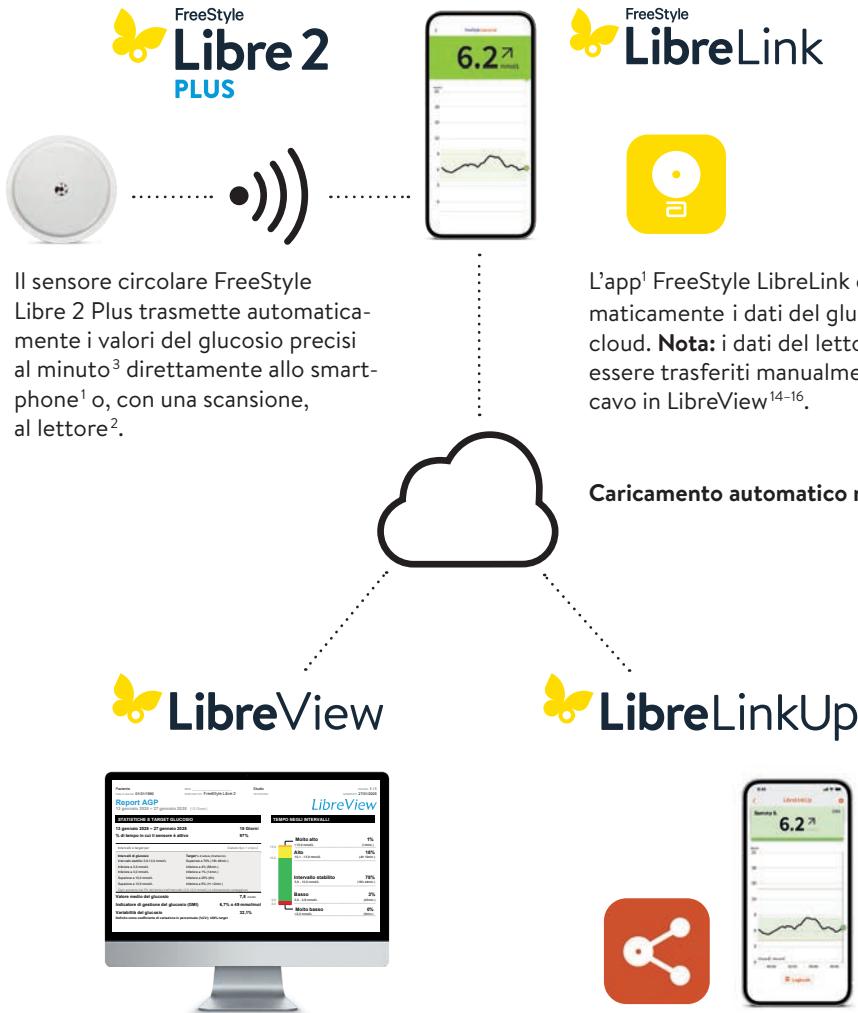

Nel sistema gratuito di gestione dei dati LibreView¹⁴⁻¹⁶, basato sul web, sono disponibili i dati completi del glucosio, rappresentati in report ed analisi comprensibili. I dati possono essere condivisi¹⁶ in tempo reale con lo studio medico curante, a condizione che sia stato creato un account.

Con l'app gratuita LibreLinkUp¹⁶⁻¹⁹, le persone invitate (ad es. i familiari) possono visualizzare¹⁶ i valori del glucosio attuali e l'andamento del glucosio delle ultime 12 ore. Inoltre possono ricevere gli allarmi¹² del glucosio in tempo reale.

Il sistema FreeStyle Libre 2 libera dal controllo di routine della glicemia^{9,20} mediante puntura del dito

FreeStyle Libre è il sistema²¹ di misurazione del glucosio più utilizzato al mondo. Per oltre 7 milioni di persone con diabete, la misurazione della glicemia tramite puntura del dito appartiene ormai al passato.


Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus non misura gli zuccheri nel sangue, ma nei tessuti.

Misurazione degli zuccheri con sensore

(CGM: Continuous Glucose Monitoring – monitoraggio continuo del glucosio)

Misurazione degli zuccheri con puntura del dito

(BGM: Blood Glucose Monitoring – monitoraggio glicemico)

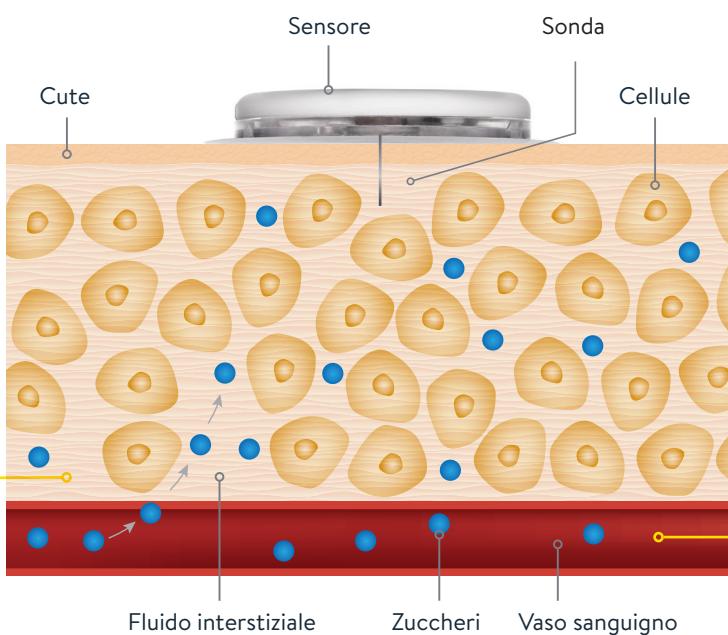

Misurazione glicemica e misurazione del glucosio tissutale: qual è la differenza?

Il sistema FreeStyle Libre 2 può sostituire le misurazioni di routine della glicemia in modo sicuro e preciso.^{8,9,22} Il dosaggio dell'insulina può essere adeguato in base ai valori del glucosio tissutale.²⁰



Il **sensore FreeStyle Libre 2 Plus** misura il glucosio nei tessuti (più precisamente: nel fluido tra le cellule, detto anche fluido interstiziale) mediante una **sonda** (filamento) inserita.



La **misurazione glicemica** avviene nel sangue capillare mediante una **goccia di sangue**, ottenuta pungendo il dito.




Ritardo temporale: valore glicemico e del glucosio tissutale

È del tutto normale che il valore della glicemia e quello del glucosio tissutale siano diversi in determinate situazioni, perché il glucosio impiega più tempo per penetrare nei tessuti attraverso il sangue.²²


Immaginiamo che la locomotiva rossa in testa al treno rappresenti i valori glicemici e che il vagone giallo rappresenti i valori del glucosio misurati con il sensore FreeStyle Libre 2 Plus.

L'esempio seguente spiega questo fenomeno in modo comprensibile.

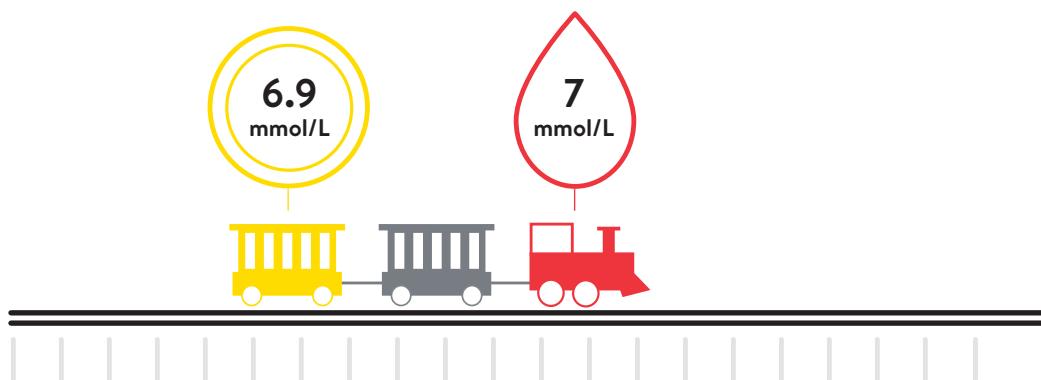

→ Quando i valori sono stabili, i valori del glucosio misurati dal sistema FreeStyle Libre 2 e i valori glicemici sono molto simili.

Nota: il controllo dei valori del glucosio deve essere ripetuto con un misuratore della glicemia, quando i sintomi non corrispondono alle letture o agli allarmi del sistema.

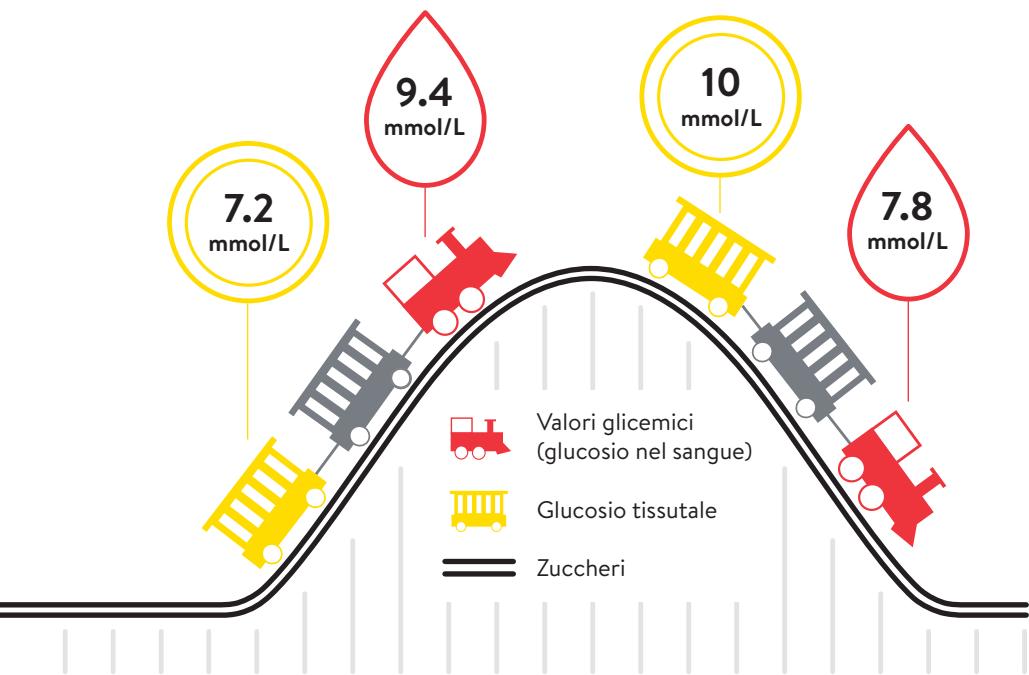

In caso di rapido aumento degli zuccheri, i valori del glucosio misurati dal sistema FreeStyle Libre 2 possono essere inferiori ai valori glicemici.



In caso di rapida diminuzione degli zuccheri, i valori del glucosio misurati dal sistema FreeStyle Libre 2 possono essere superiori ai valori glicemici.

Prima di applicare il sensore

Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus si applica⁸ facilmente e si indossa comodamente fino a 15 giorni senza quasi accorgersene. Perché aderisca bene quando indossato, osservare i consigli seguenti.

Prima di applicare il sensore:

- Scegliere un punto di applicazione sicuro sul lato posteriore della parte superiore del braccio.
- Non usare creme sul punto di applicazione perché creme e lozioni possono lasciare residui oleosi sulla cute.
- Rasare eventuali peli sul braccio che potrebbero rimanere tra la superficie adesiva del sensore e la cute.

3 passi per migliorare l'adesione del sensore

Il sensore aderisce meglio sulla cute lavata, pulita ed asciugata prima dell'applicazione.

1 Lavare

Lavare il punto di applicazione solo con sapone non idratante e privo di profumo.



2 Pulire

Per la pulizia utilizzare una salvietta²³ imbevuta di alcol, non idratante e priva di additivi (es. glicerina); lasciare asciugare la cute all'aria.



3 Asciugare

Attendere che la cute sia completamente asciutta prima di applicare il sensore, soprattutto dopo la doccia o dopo il nuoto⁷.



Per pulire il punto di applicazione **non** utilizzare disinfettanti o salviette per le mani.

Consigli per una migliore adesione del sensore

PROBLEMA	CONSIGLIO
Cute oleosa: il sapone, la crema, lo shampoo o il balsamo possono lasciare dei residui oleosi sulla pelle e impedire che il sensore aderisca correttamente.	Per migliorare l'adesione, prima di procedere lavare la cute con acqua e sapone, asciugare, pulire con una salvietta imbevuta di alcol e lasciare asciugare all'aria (non soffiare sulla cute).
Cute bagnata o umida: l'umidità rende difficile l'adesione. Mantenere la cute asciutta prima dell'applicazione.	Per migliorare l'adesione, prima di procedere lavare la cute con acqua e sapone, asciugare, pulire con una salvietta imbevuta di alcol e lasciare asciugare all'aria (non soffiare sulla cute).
Cute con peli: i peli corporei possono insinuarsi tra la cute e l'adesivo del sensore.	Il punto scelto sul lato posteriore della parte superiore del braccio deve essere ben rasato.



Ausili per l'adesione del sensore

Applicazione di cerotti, medicazioni o tape sul sensore

- Non coprire il foro del sensore.**
- Medicazioni o tape aggiuntivi devono essere applicati **contemporaneamente** con il sensore e tolti solo quando il sensore è **pronto per essere rimosso**.
- Utilizzare cerotti, medicazioni o tape di grado medico.

Migliore adesione del sensore

I prodotti seguenti potrebbero essere d'aiuto per **migliorare l'adesione del sensore**. La cute è diversa da persona a persona: probabilmente occorrerà provare diversi prodotti per trovare quello adatto. Rivolgersi al team di diabetologia per scegliere l'opzione migliore.

PRODOTTO*	DESCRIZIONE
Torbot Skin Tac	Salvietta adesiva per la cute ipoallergenica e priva di lattice (torbot.com)
SKIN PREP Salviette protettive per la cute	Medicazione liquida protettiva che consente alla cute di respirare, migliorando l'adesione di nastri adesivi e film (smith-nephew.com)
Mastisol Liquid Adhesive	Adesivo liquido trasparente, delicato sulla cute, non solubile in acqua, per fissare le medicazioni anche in aree umide (eloquesthealthcare.com)
Tegaderm IV	Film trasparente con resistenza adesiva (3m.com)
Medicazione di fissaggio	Adesivo di grado medico; bendaggio o nastro adesivo

* Le informazioni fornite non sono raccomandazioni di un determinato produttore né raccomandazioni riguardanti una qualità di un prodotto. Abbott Diabetes Care non è responsabile della completezza o accuratezza delle informazioni sul prodotto di altri fabbricanti. La disponibilità di un prodotto può variare in base al paese e alla regione. Seguire le istruzioni del produttore per l'utilizzo del prodotto prescelto.

Consigli per indossare il sensore



PRUDENZA

Fare sempre attenzione che il sensore non resti impigliato a telai di porte, portiere di auto, cinture di sicurezza o spigoli di mobili.



SPORT DI CONTATTO E ATTIVITÀ SPORTIVA INTESA

Scegliere accuratamente il punto di applicazione sul lato posteriore della parte superiore del braccio per ridurre al minimo il rischio che il sensore venga strappato. Eventualmente proteggere il sensore con un cerotto, una medicazione o un tape²⁴.



ASCIUGATURA

Dopo la doccia o il nuoto⁷ asciugarsi facendo attenzione a non impigliare e strappare il sensore.



MOVIMENTI LENTI

Quando ci si veste e sveste, fare attenzione che il sensore non si impigli negli abiti.



ABITI COMODI

Indossare abiti comodi e di tessuto leggero in modo che il sensore abbia spazio a sufficienza.



GIÙ LE MANI

Non giocherellare con il sensore, non tirarlo né toccarlo in altro modo quando è indossato.

Scaricare l'app

1 Verificare la compatibilità

L'app¹ FreeStyle LibreLink è compatibile solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di scaricare l'app, verifichi che il Suo smartphone sia compatibile. L'elenco di compatibilità è disponibile nel sito www.FreeStyle.Abbott oppure scansionando direttamente questo codice QR:



2 Scaricare l'app gratuitamente

Cercare nell'**App Store** (iPhone) _____



- Aprire l'Apple App Store
- Selezionare «Cerca» in basso a destra
- Inserire «FreeStyle LibreLink» nella casella di ricerca e cliccare su «Cerca»
- Scorrere fino all'app FreeStyle LibreLink e cliccare su «Scarica»

o in **Google Play** (smartphone Android) _____



- Aprire Google Play
- Inserire «FreeStyle LibreLink» nella casella di ricerca e cliccare sulla lente d'ingrandimento
- Scorrere fino a FreeStyle LibreLink e selezionare l'app
- Cliccare su «Installa» nella vista dettagliata dell'app

3 Scaricare e aprire l'app _____



Valori del glucosio e allarmi¹²:

Trasmissione dei dati precisi al minuto³ all'app tramite Bluetooth¹¹

- Verificare che il Bluetooth sia ATTIVO nelle impostazioni dello smartphone.
- Non è necessaria la connessione di rete per controllare nell'app i valori del glucosio, ricevere gli allarmi, aggiungere note o analizzare l'andamento dei propri valori.



L'app deve rimanere aperta in background. Forzando la chiusura dell'app non si riceveranno né gli allarmi né i valori del glucosio.

4

Creare un account utente

Quando si configura l'app, consigliamo di creare un account in LibreView¹⁴⁻¹⁶, con cui può eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare chiaramente i dati e i report online, in una pagina dedicata nel sito www.LibreView.com.
- Condividere i dati con il team di diabetologia tramite l'opzione «App connesse».
- Controllare i dati storici e continuare a utilizzare il sensore attivo in caso di sostituzione del dispositivo ricevente (ad es. a seguito di smarrimento o sostituzione dello smartphone).

Nota: il login per l'app FreeStyle LibreLink e per LibreView è identico.

5

Registrazione

Seguire i passi visualizzati sullo smartphone per la registrazione.

Annotare qui l'indirizzo e-mail e la password utilizzati:

Indirizzo e-mail: _____

Password: _____



Applicazione del sensore

Appicare il sensore è facilissimo⁸.
Seguire i passaggi indicati di seguito:



1


Scegliere un'area cutanea sul **lato posteriore della parte superiore del braccio**, che normalmente rimane piatta (senza pieghe o angolazioni) durante le normali attività quotidiane. Scegliere un punto distante almeno 2,5 cm dal punto di iniezione dell'insulina. Per evitare disturbi o irritazioni cutanee, scegliere un **punto diverso dall'ultimo utilizzato**.



2

Lavare il punto di applicazione con sapone non idratante e senza profumo, quindi asciugarlo e **pulirlo** con una salvietta imbevuta di alcol (non idratante e senza additivi, come glicerina). In questo modo si rimuovono i residui oleosi, che altrimenti impedirebbero la corretta adesione del sensore. Prima di proseguire lasciare **asciugare** la zona all'aria.


Nota: l'area della cute **dove deve essere pulita e asciutta**, altrimenti il sensore non aderisce.



3

Aprire la confezione del sensore togliendo **completamente** la pellicola protettiva.


4



Rimuovere il cappuccio dell'applicatore del sensore e conservarlo.


Attenzione: non utilizzare se la confezione del sensore o l'applicatore del sensore sono visibilmente danneggiati o già aperti. **Non** usare dopo la data di scadenza indicata.

5



Allineare i segni scuri dell'applicatore del sensore con i **segni scuri** presenti sulla confezione. Premere saldamente e a fondo l'applicatore del sensore sulla confezione. Quando si esegue questa operazione, mantenere la confezione del sensore su una superficie dura, stabile e piana, ad es. un tavolo.

6



Estrarre l'applicatore del sensore dalla confezione – il sensore è ora inserito in modo sicuro nell'applicatore.

7



Posizionare **l'applicatore del sensore** sull'area preparata e premerlo **saldamente sulla pelle**. Un sensore piccolo, sottile e flessibile viene inserito sotto la cute. Normalmente non si avverte nulla⁸.

Attenzione: premere l'applicatore del sensore sulla cute soltanto quando si trova sull'area della cute preparata per evitare un involontario posizionamento errato o possibili lesioni.

8



Rimuovere **con cautela** **l'applicatore del sensore dal braccio**. Ora il sensore dovrebbe aderire alla pelle.

9



Verificare che il **sensore sia saldamente inserito**. Ogni cute è diversa – esistono prodotti che possono migliorare l'adesione del sensore. Vedere pagina 12.

Il sensore è ora pronto per essere avviato in modo attivo. **A tale scopo, con una scansione iniziale è necessario stabilire la connessione del sensore allo smartphone¹ e/o all'app¹ FreeStyle Libre 3 oppure, in alternativa, sul lettore².**

Avviare con l'app:
Leggere come fare a pag. 20–21.

Avviare con il lettore:
leggere come fare a pag. 49.



Attenersi anche al foglietto illustrativo.

Avvio del sensore

Avviare il sensore

Per ricevere i valori del glucosio avviare il sensore FreeStyle Libre 2 Plus, precedentemente applicato sul lato posteriore della parte superiore del braccio, con una scansione iniziale. A tale scopo tenere lo smartphone¹ sopra al sensore ad una distanza massima di 4 cm. In questo modo il sensore si collega allo smartphone e/o all'app¹ FreeStyle LibreLink.



Nella schermata iniziale dell'app toccare il pulsante «**Eseguire scansione nuovo sensore**». Lo smartphone è ora pronto a scansionare il sensore per poterlo **avviare**.



Nell'iPhone, l'antenna NFC* (Near Field Communication) si trova sul bordo superiore. **Scansionare il sensore toccandolo con il LATO SUPERIORE dello smartphone.**



Dalla **schermata iniziale dell'app** scansionare il sensore con il RETRO dello smartphone per poterlo **avviare**.



Nella maggior parte degli smartphone Android, l'antenna NFC* (Near Field Communication) si trova sul retro. **Scansionare il sensore toccandolo con il RETRO dello smartphone.**

⚠ IMPORTANTE: attivare la NFC.

* Che cos'è la NFC?


L'acronimo NFC sta per Near Field Communication (in italiano: comunicazione a corto raggio), una tecnica a radiofrequenza per trasmettere i dati a breve distanza, al massimo quattro centimetri. La NFC stabilisce la connessione tra il sensore e lo smartphone e/o il lettore.

Consigli per avviare il sensore:

- Ⓐ La vicinanza, l'orientamento dello smartphone e altri fattori possono influenzare le prestazioni della funzionalità NFC. Ad esempio, una custodia metallica spessa può compromettere il segnale NFC.
Si noti che la maggiore o minore facilità di scansione del sensore dipende dal modello dello smartphone. Ogni modello di smartphone è diverso dall'altro.
Toccare il sensore con lo smartphone oppure muovere lentamente lo smartphone avanti e indietro in modo da apprendere la procedura migliore per scansionare il sensore.
- Ⓐ Dopo avere avviato con successo il sensore, si sente un suono oppure si avverte una vibrazione. Se il volume dello smartphone è disattivato, non si ode il suono.

Nota sul ricevimento dei valori del glucosio:

Una volta avviato il sensore, **dopo 60 minuti** riceverà i Suoi primi valori del glucosio direttamente e automaticamente sullo smartphone.

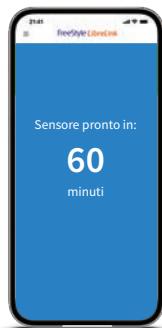

Note su app, lettore e allarmi:

- Se il **sensore è stato avviato con l'app**¹, i valori del glucosio vengono visualizzati precisi al minuto³ direttamente sullo smartphone. Non si può utilizzare anche il lettore².
- Se il **sensore è stato avviato con il lettore**, i valori del glucosio si ricevono con una scansione sul lettore e, in via opzionale, anche sullo smartphone. Gli allarmi vengono ricevuti solo sul lettore.
- I valori del glucosio e gli allarmi¹² impostati vengono emessi² solo sul **dispositivo collegato per primo**.



Ulteriori informazioni sono disponibili nei nostri manuali online:
<https://www.diabetescare.abbott/support/manuals/ch.html>

Indicazioni per indossare il sensore



APPLICAZIONE DEL SENSORE

Appicare il nuovo sensore ogni volta in un punto diverso del lato posteriore della parte superiore del braccio. Non applicare il sensore subito dopo avere fatto la doccia o un bagno completo.



INTERPRETAZIONE DEI VALORI DEL GLUCOSIO

Si noti che le variazioni delle concentrazioni di glucosio nei tessuti possono richiedere più tempo. Evitare quindi correzioni eccessive!

Le frecce della tendenza aiutano a stimare la velocità e la direzione di cambiamento del valore del glucosio.



GESTIONE DEI DATI

Se si utilizza il software LibreView¹⁴⁻¹⁶ è possibile condividere i report con il proprio team di diabetologia.¹⁶

Utilizzo della funzione Aggiungi nota:

Può registrare cosa ha mangiato, le dosi di insulina e le attività sportive sotto forma di note nell'app FreeStyle LibreLink. Questo permette a Lei o al Suo team di diabetologia di interpretare meglio i valori.

E inoltre:

Le dosi di insulina registrate con una smartpen¹⁰ compatibile possono essere trasferite facilmente nell'app FreeStyle LibreLink.



TEMPERATURA

Freddo

Il sensore può reagire alle basse temperature invernali, quindi potrebbe non visualizzare temporaneamente i valori del glucosio. Non appena il sensore si è scaldato a circa 10 °C, i valori possono essere nuovamente visualizzati.

Calore

Il sensore può reagire a temperature estremamente elevate, ad esempio quelle presenti all'interno di sauna, quindi potrebbe non visualizzare temporaneamente i valori del glucosio. Non appena il sensore si è raffreddato a circa 45 °C, i valori possono essere nuovamente visualizzati.



TEMPO LIBERO

È possibile fare il bagno, la doccia, nuotare o andare in sauna con il sensore impermeabile⁷. L'uso di una medicazione di fissaggio o di un tape di grado medico offre un'ulteriore protezione²⁴ del sensore. A tale scopo attenersi anche ai consigli per indossare il sensore riportati a pagina 13.



VIAGGI

Quando si viaggia in aereo, i sensori vanno sistemati nel bagaglio a mano. Farsi rilasciare una certificazione medica per informare il personale di sicurezza aeroportuale.

Da pianificare in anticipo:

Portare con sé un numero sufficiente di sensori di ricambio in modo da disporre di un rifornimento adeguato.



ESAME MEDICO

Prima di qualsiasi esame che comporti l'esposizione a forti radiazioni magnetiche o elettromagnetiche (ad es. radiografie, RM (risonanza magnetica) o TC (tomografia computerizzata)), consultare il foglietto illustrativo o il manuale d'uso sul nostro sito web: www.FreeStyle.Abbott.

Ulteriori informazioni sono disponibili nei nostri manuali online:
<https://www.diabetescare.abbott/support/manuals/ch.html>



Rimozione del sensore

Rimuovere il sensore

- Sollevare il bordo della pellicola adesiva che fissa il sensore sulla pelle.
- Staccare lentamente il sensore dalla pelle con un unico movimento.
- Utilizzare eventualmente salviette rimuovi-adesivo per rimuovere senza traumi eventuali medicazioni adesive e residui di adesivo.

Nota: gli eventuali residui di adesivo sulla cute possono essere eliminati con acqua calda e sapone o con alcol isopropilico.

PRODOTTO*	DESCRIZIONE
Olio corpo bimbi	Idratante delicato
REMOVE Salviette rimuovi-adesivo	Elimina i residui di adesivo dalla cute (smith-nephew.com)
UNI-SOLVE Rimuovi-adesivo	La formulazione riduce il trauma provocato dall'adesivo sulla cute sciogliendo accuratamente cerotti per medicazioni e adesivi (smith-nephew.com)

* Vedere la nota a pag. 12.



Smaltimento dei componenti del sistema FreeStyle Libre 2

I componenti del sistema FreeStyle Libre 2 possono essere smaltiti come segue:

Con il corretto smaltimento dei singoli componenti e delle parti dell'imballaggio del sistema FreeStyle Libre 2, può dare un importante contributo al circuito del riciclo.

RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	RACCOLTA DEL CARTONE
Sensore (nuovo o usato)	Imballaggio esterno 
Lettore (nuovo o usato)	CARTA USATA 
Cavo USB e alimentatore	PLASTICA 
CENTRO DI RACCOLTA PER OGGETTI APPUNTITI/TAGLIENTI	
Applicatore del sensore, compreso il cappuccio	Imballaggio del sensore Solo confezione vuota, dopo l'applicazione del sensore FreeStyle Libre 2 Plus.  Informarsi eventualmente anche presso il più vicino centro di smaltimento o l'autorità dei rifiuti locale.

Le immagini hanno esclusivamente scopo illustrativo.

Nota: poiché lettori e sensori possono essere stati esposti a fluidi corporei, prima dello smaltimento è possibile pulirli, ad es. con un panno inumidito in una miscela composta da una parte di candeggina per uso domestico e nove parti di acqua.



Cosa offre l'app FreeStyle LibreLink

Valori del glucosio sullo smartphone¹

Con l'app¹ FreeStyle LibreLink ha sempre³ a disposizione la panoramica completa dei Suoi valori del glucosio e altri utili dati.

Vantaggi della app FreeStyle LibreLink:



TRASMISSIONE AUTOMATICA

Ricevimento dei valori del glucosio precisi al minuto³ direttamente e automaticamente sullo smartphone¹.



ALLARMI¹² DEL GLUCOSIO OPZIONALI

Sapere direttamente e con una precisione al minuto quando i valori sono superiori o inferiori ai limiti di allarme predefiniti. Il sensore è discreto⁴ e sicuro soprattutto nei range⁸ bassi del glucosio.



DISPONIBILE IN 26 LINGUE

FreeStyle LibreLink segue l'impostazione della lingua del telefono ed è disponibile in diverse lingue.



FACILE CONDIVISIONE¹⁶

Grazie all'app si possono condividere^{16,18} facilmente i dati del glucosio con il team di diabetologia tramite LibreView¹⁴⁻¹⁶ e con familiari o amici tramite LibreLinkUp^{17,19}.



EMISSIONE VOCALE OPZIONALE

Per chi ha problemi di vista è disponibile l'emissione vocale per ascoltare comodamente i valori del glucosio e la tendenza.



FUNZIONE NOTA

Per registrare in qualsiasi momento cosa ha mangiato, le dosi di insulina o le attività sportive.



PENNE DA INSULINA INTELLIGENTI

Per scansionare la smartpen¹⁰ compatibile e trasmettere le dosi di insulina applicate direttamente all'app.

Tutto a colpo d'occhio

Con l'app¹ FreeStyle LibreLink ha sempre a disposizione la panoramica completa dei Suoi valori del glucosio e altri utili dati.



Note:

- Se il sensore è stato avviato con l'app, i valori del glucosio vengono visualizzati direttamente sullo smartphone oppure possono essere letti con una scansione³.
- L'app FreeStyle LibreLink può essere collegata anche al lettore² durante l'intera durata d'uso del sensore.
- Gli allarmi impostati¹² vengono emessi solo sul dispositivo collegato per primo.

Sistema a semaforo per una maggiore comodità

L'attuale valore del glucosio determina il colore dello sfondo dell'app¹. Così basta un'occhiata per capire in quale range si trova il valore del glucosio.

I colori del semaforo indicano se il valore del glucosio:

è troppo alto (superiore a 13.9 mmol/L)

è tra il range target e 13.9 mmol/L

è nel range target

è tra il range target e 3.9 mmol/L

è troppo basso (inferiore a 3.9 mmol/L)






Più tempo nel range target con il sistema FreeStyle Libre 2

Cos'è il tempo nel range target?


Il tempo nel range target, o «**Time in Range**» (TIR), è la percentuale di tempo che una persona trascorre con il livello di glucosio nel range target.

Esempi di tempo nel range target (range verde)



Nell'app¹ FreeStyle LibreLink il range target del glucosio è preimpostato a 3.9–10.0 mmol/L.²⁶ Il range target può essere adattato con le impostazioni ed è visualizzato nell'app in verde chiaro.

Il sistema FreeStyle Libre 2 calcola automaticamente il tempo trascorso **nel, sopra e sotto il range target**. Questi dati sono disponibili nell'app o in LibreView¹⁴⁻¹⁶ nel report «**Tempo nei range**».

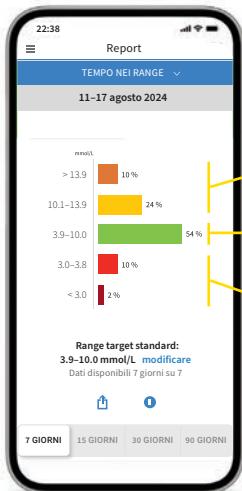

Nell'app FreeStyle LibreLink il tempo nel range target (54% nell'esempio) è indicato da una barra verde:

Tempo sopra il range target (>10.0 mmol/L)

Range target del glucosio (3.9-10.0 mmol/L)

Tempo sotto il range target (<3.9 mmol/L)

Perché è importante il tempo nel range target?

Più tempo nel range target significa un valore dell'HbA1c più basso.²⁷

Il valore dell'HbA1c viene calcolato in laboratorio e rispecchia il livello medio degli zuccheri nel sangue nelle ultime otto-dodici settimane.



Ogni aumento del tempo nel range target del 10% può ridurre il valore dell'HbA1c dello 0,8%.²⁸



Ogni ora in più nel range target influisce positivamente sul controllo del glucosio.²⁶




Più tempo nel range target può ridurre le complicanze per la salute a lungo termine.²⁹



Le linee guida raccomandano di trascorrere almeno il 70% del tempo nel range target (3.9–10.0 mmol/L).^{26,30}

Scopri come le Sue decisioni quotidiane influiscono sul glucosio

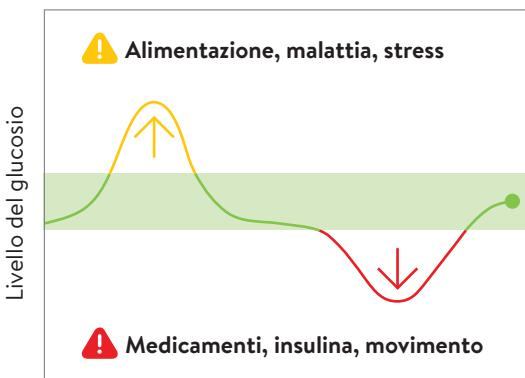

CONSIGLI

- Ridurre gli «inconvenienti» maggiori, come i carboidrati pesanti
- Controllare regolarmente i valori del glucosio
- Ripetere i comportamenti che funzionano



Consulti il Suo team di diabetologia per sapere come impostare il Suo range target. Può annotare i valori del Suo range target nell'ultima pagina.

La freccia della tendenza indica la direzione

La freccia della tendenza indica la direzione in cui si sta muovendo il valore del glucosio:



Il valore del glucosio aumenta rapidamente
cioè più di 0.1 mmol/L al minuto



Il valore del glucosio aumenta
cioè tra 0.06 e 0.1 mmol/L al minuto



Il valore del glucosio cambia lentamente
cioè meno di 0.06 mmol/L al minuto



Il valore del glucosio diminuisce
cioè tra 0.06 e 0.1 mmol/L al minuto





Il valore del glucosio diminuisce rapidamente
cioè più di 0.1 mmol/L al minuto

Una freccia della tendenza in forte calo può comparire, ad esempio, quando viene somministrata insulina ad azione rapida oppure durante o dopo un'attività sportiva.

Presti particolare attenzione o assuma carboidrati con effetto rapido quando appare questa freccia della tendenza e ha già bassi valori del glucosio.

Utilizzare la funzione Aggiungi nota dell'app¹ FreeStyle LibreLink.


Nell'app FreeStyle LibreLink è possibile registrare, modificare e visualizzare eventuali note nel «Diario» anche in un secondo momento.

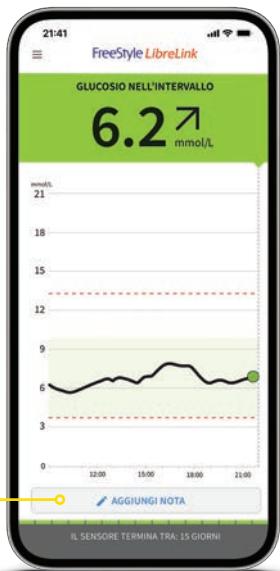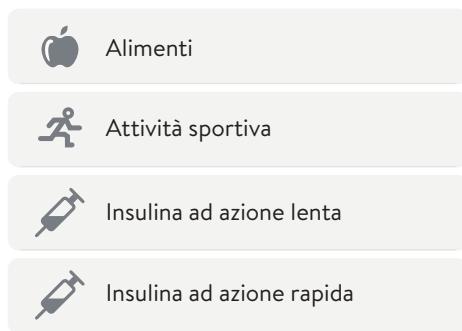

Il diario – Tutti gli eventi della giornata a colpo d'occhio

Il diario offre una panoramica in qualsiasi momento.

Nella sezione «Diario» sono riportati tutti gli allarmi¹², i valori del glucosio scansionati e le note in sequenza oraria e con il corrispondente valore del glucosio.

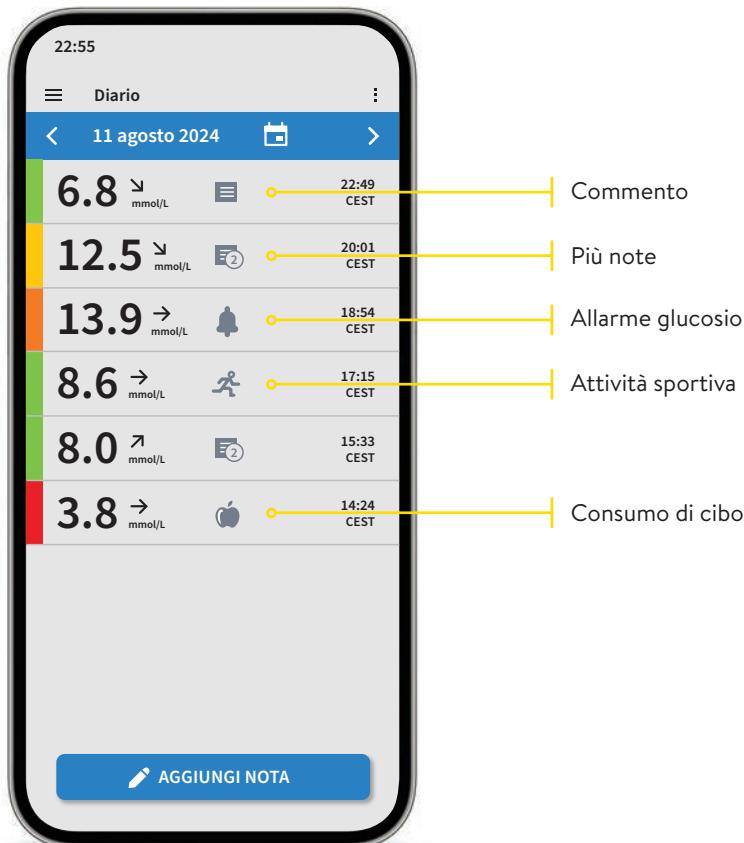


Nota: si possono aggiungere note anche in un secondo momento toccando la funzione «**Aggiungi nota**» nella pagina iniziale o in basso nel diario.



Ricevere report dettagliati sui valori del glucosio

Controllare e capire l'andamento del glucosio può essere utile per migliorarne la gestione.^{26,31,32}

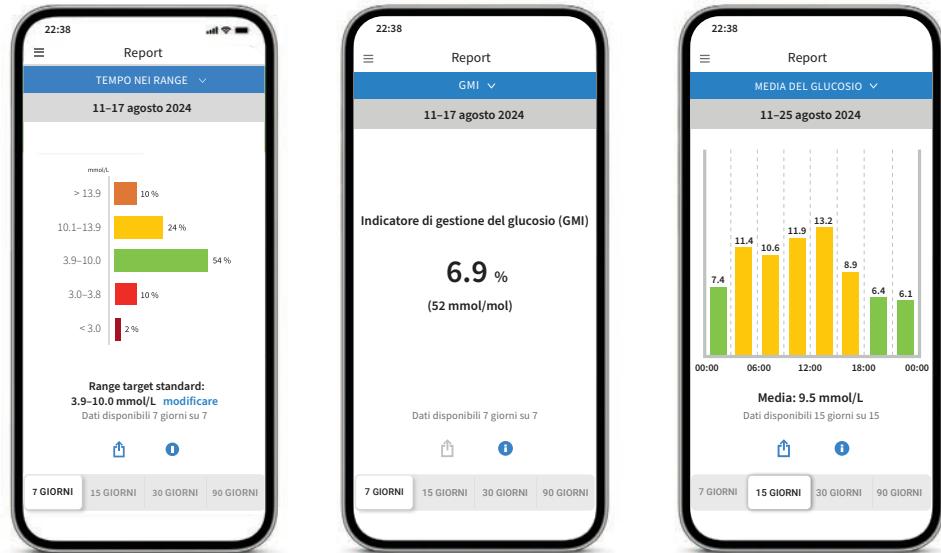

Report «Tempo nei range»

Può visualizzare l'analisi del tempo nel range target secondo i Suoi parametri personali selezionando **«Personalizzato»**, oppure secondo i parametri raccomandati dalle linee guida internazionali selezionando **«Standard»**.

Report «GMI» (indicatore di gestione del glucosio)


Può essere utilizzato come indicatore della correttezza con cui è controllato il metabolismo del glucosio. **Nota:** il GMI è diverso dal valore dell'HbA1c, che viene calcolato in laboratorio da un campione di sangue.

Report «Valore medio del glucosio»

Mostra informazioni sui valori medi del glucosio, anche per diverse fasce orarie del giorno. I valori al di sopra del range target sono di colore giallo o arancione, mentre i valori al di sotto del range target sono di colore rosso.

Allarmi del glucosio opzionali e impostabili individualmente

Un allarme¹² del glucosio viene attivato non appena il valore del glucosio supera o scende al di sotto dei limiti stabiliti. I valori limite degli allarmi non coincidono con il range target del glucosio.

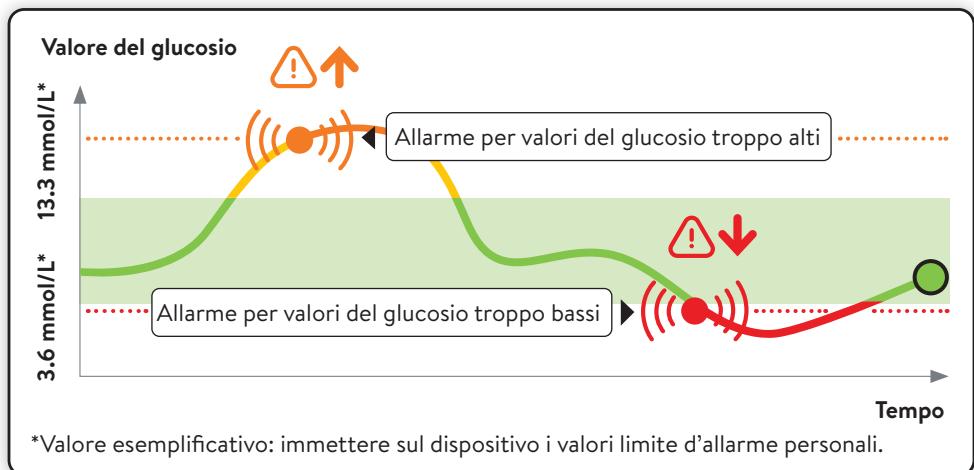

*Valore esemplificativo: immettere sul dispositivo i valori limite d'allarme personali.

Consulti il Suo team di diabetologia per sapere quali valori limite di allarme impostare.
Può annotare i Suoi valori limite di allarme personali nell'ultima pagina.



Valori limite di allarme da decidere personalmente

Gli allarmi¹² si attivano in caso di:



**valori del glucosio
troppo bassi**
regolabili nell'intervallo
3.3–5.6 mmol/L



**valori del glucosio
troppo alti**
regolabili nell'intervallo
6.7–22.2 mmol/L



perdita di segnale^{13,35},
se il sensore non ha potuto
stabilire una connessione con
l'app per 20 minuti




Avvisare

L'allarme si attiva se i valori del glucosio sono troppo bassi o troppo alti.



Controllare

Confermare l'allarme sullo smartphone o sul lettore e controllare il valore del glucosio.

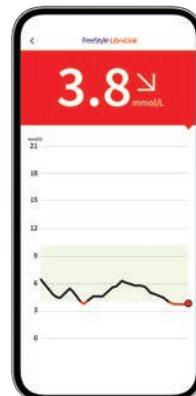

Agire


Utilizzare le informazioni per adottare le opportune misure.

Allarmi del glucosio opzionali e impostabili individualmente

È possibile decidere se e quando si desidera utilizzare gli allarmi¹².

Gli allarmi sono disattivati per impostazione predefinita. Desidera attivare gli allarmi?


È facile:

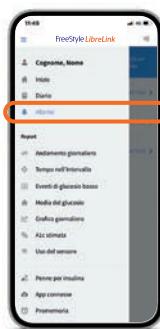

- 1 Toccare nel menu «Allarmi».





- 2 Toccare l'allarme «Glucosio basso».

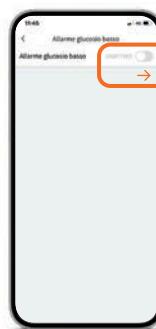

- 3 Toccare il cursore o farlo scorrere verso destra per attivare l'allarme.



- 4 L'allarme «Perdita di segnale» si attiva automaticamente non appena viene attivato un allarme per la prima volta. Può essere disattivato e riattivato in qualunque momento.

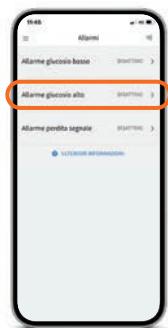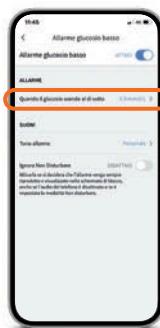

- 5 Toccare «Quando il glucosio scende al di sotto ... mmol/L.». Impostare il valore limite di allarme personalizzato scorrendo verso l'alto o verso il basso; quindi toccare «Salva».

- 6 Solo iPhone: per regolare il tono, selezionare «Tono allarme» per scegliere tra «Personale» o «Standard».

- 7 Procedere allo stesso modo per impostare l'allarme «Glucosio alto».

Allarme in caso di perdita di segnale

L'allarme «**Perdita di segnale**¹³» La informa quando:

- manca la connessione tra il sensore e lo smartphone¹ per più di 20 minuti oppure
- lo smartphone dista dal sensore più di 6 metri¹¹.



Per un profilo glicemico completo, scansionare una volta il sensore FreeStyle Libre 2 Plus quando si verifica una perdita di segnale.

Eventuali dati mancanti possono essere recuperati con una scansione al massimo per il periodo delle ultime 8 ore.

Può capitare che l'app¹ FreeStyle LibreLink non possa ricevere i valori del glucosio per un breve periodo, ad es. a causa di alte temperature all'interno di una sauna. In questo caso, un messaggio d'errore sull'app FreeStyle LibreLink avverte l'utilizzatore.



Nota: lo smartphone può ricevere gli allarmi¹² del glucosio da una distanza massima di 6 metri. L'allarme di perdita di segnale viene attivato automaticamente non appena si attiva per la prima volta un allarme del glucosio. È possibile disattivare e riattivare l'allarme di perdita di segnale in qualsiasi momento.


Come ricevere gli allarmi con l'app FreeStyle LibreLink

Autorizzare le notifiche per ricevere gli allarmi¹²:




iPhone:

- 1 Nel menu «**Impostazioni**» dello smartphone, sotto «**Notifiche**», selezionare l'app¹ FreeStyle LibreLink.
- 2 Attivare la funzione «**Consenti notifiche**».
- 3 Attivare **tutte** le opzioni di notifica (blocco schermo, messaggi, banner).

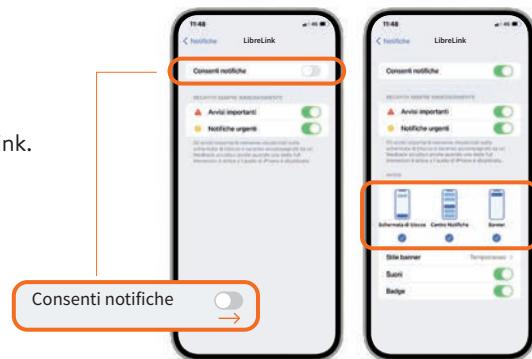


Smartphone Android:

- 1 Selezionare nel menu «**Impostazioni**» dello smartphone, sotto «**App**», l'app FreeStyle LibreLink.
- 2 Andare a «**Notifiche**».
- 3 Attivare le notifiche per non perdere alcun allarme.

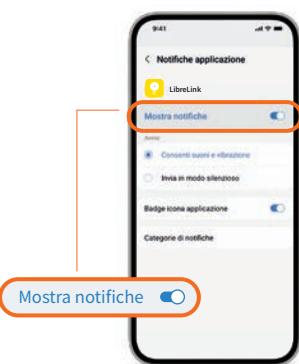

Cambiare i toni di allarme (iPhone):

Nel menu principale dell'app selezionare «**Allarmi**» e l'allarme che si desidera modificare. Sotto «**Tono allarme**» è possibile scegliere tra «**Personale**» e «**Standard**».

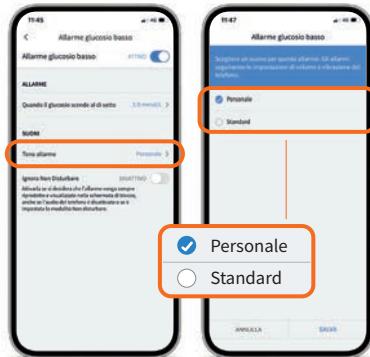

Impostazioni importanti per poter ricevere gli allarmi

In generale:

Impostazioni Bluetooth¹¹

Per poter ricevere gli allarmi¹² occorre attivare il **Bluetooth quando si avvia** un sensore FreeStyle Libre 2 Plus. Il Bluetooth deve essere **permanentemente attivo** per poter ricevere gli allarmi.

Notifiche di allarme

Attivare le notifiche sul blocco schermo, le notifiche, le notifiche di canale, le notifiche di suono e di pop-up e i suoni in generale o la vibrazione dello smartphone.

iPhone:

Regolazione della modalità Focus e delle «Notifiche sensibili»

Se utilizza la funzione Focus sull'iPhone, è importante che regoli **ciascuna modalità Focus in modo da attivare l'opzione «Notifiche urgenti»** dell'app¹ FreeStyle LibreLink, portando l'interruttore su **ON**. Inoltre deve accertarsi che nelle **impostazioni del Suo cellulare siano attivate le «Notifiche sensibili»** per l'app FreeStyle LibreLink, posizionando l'interruttore su **ON**.

Smartphone Android:

Attivare la geolocalizzazione

Negli smartphone Android occorre **attivare la geolocalizzazione** per **collegarsi** con i dispositivi Bluetooth e, quindi, **ricevere gli allarmi**. I sensori FreeStyle Libre 2 Plus non acquisiscono la Sua posizione e non possono trasmettere queste informazioni all'app.

Autorizzazione per «Dispositivi nelle vicinanze» (valida per sistema operativo 12 o versioni successive)

L'autorizzazione per «Dispositivi nelle vicinanze» consente a un'app (app¹ FreeStyle LibreLink) di trovare eventuali dispositivi nelle vicinanze (sensore) con l'ausilio del Bluetooth, di collegarsi con gli stessi e di rilevarne la posizione.

È importante che questa **autorizzazione sia sempre attivata per l'app FreeStyle LibreLink** per garantire che l'app mantenga la connessione con il sensore e che non si verifichi una perdita di segnale.

Modalità Non disturbare

Disattivare la **modalità Non disturbare** oppure modificare le impostazioni degli allarmi in modo da escluderla. In caso contrario è possibile che l'app non emetta gli allarmi.

Nota: per ulteriori informazioni riguardanti l'app e le sue singole funzioni, consultare il relativo manuale d'uso sotto «Guida -> Manuale d'uso».

Simboli importanti

Se almeno un allarme¹² è attivato ma le impostazioni non sono state eseguite correttamente, nell'app¹ FreeStyle LibreLink compaiono i seguenti segnali di avvertimento:



Simbolo del menu principale, quando gli allarmi non sono disponibili.



Simbolo del menu Allarmi, quando gli allarmi non sono disponibili.

Controllare anche le impostazioni necessarie nelle pagine 40–41.

Gli allarmi non sono disponibili nell'app FreeStyle LibreLink se almeno un allarme è attivato e se è presente almeno una delle seguenti condizioni:



Il Bluetooth è disattivato



Le notifiche sono disattivate



I toni di notifica sono disattivati



Il sensore non comunica con l'app da almeno 5 minuti



Non è attivo alcun sensore FreeStyle Libre 2 Plus



Le geolocalizzazioni sono state rifiutate

Grazie alla funzione acustica e vibrante, non sfugge nessun allarme

Gli allarmi hanno una funzione acustica e vibrante.

- Utilizzare la funzione acustica in ambienti rumorosi (ad es. durante lo shopping). Quando la funzione acustica è attivata, i tre allarmi hanno suoni diversi.
- Utilizzare la funzione vibrante per discrezione (ad es. al cinema). La modalità di vibrazione è la stessa per tutti gli allarmi.
- È possibile disattivare la funzione vibrante e acustica. Gli allarmi continuano ad essere visualizzati sullo schermo.

Quando la funzione acustica è attivata, i tre allarmi hanno suoni diversi. La modalità di vibrazione è la stessa per tutti gli allarmi.



Nota: per ulteriori informazioni riguardanti l'app e le sue singole funzioni, consultare il relativo manuale d'uso sotto «Guida -> Manuale d'uso».



Comfort, collegamento e controllo con l'app FreeStyle LibreLink

Maggiori informazioni con l'app¹ FreeStyle LibreLink

Straordinaria precisione⁸, senza punture del dito^{8,9,20} di routine

Valori del glucosio precisi al minuto e allarmi¹²

Report facilmente comprensibili con indicazione del tempo nel range target

Misurazione del glucosio con una rapida scansione di 1 secondo

Ricevimento dei valori del glucosio e degli allarmi direttamente sullo smartphone¹

Ricevimento dei valori storici del glucosio grazie al caricamento automatico¹⁶ e al salvataggio su server in cloud sicuri¹⁵ (a condizione che sia stato creato un account)

Condivisione semplice e automatica dei dati del glucosio con il team di diabetologia tramite LibreView¹⁴⁻¹⁶ e con familiari e amici tramite LibreLinkUp¹⁶⁻¹⁹

Migliore controllo* del glucosio con l'app che con il lettore² (*media del glucosio più bassa, minori fluttuazioni del glucosio e più tempo nel range target)²⁶

Facili aggiornamenti con l'app per funzioni estese quali integrazione di smartpen¹⁰, precisione e scambio di dati

Notifiche direttamente su smartwatch^{33,34} compatibili quando il valore del glucosio è troppo basso o troppo alto, sempre e ovunque¹⁶

Nota: l'app FreeStyle LibreLink e il lettore FreeStyle Libre 2 hanno funzioni simili, ma non identiche. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus comunica con il lettore FreeStyle Libre 2 e/o con l'app FreeStyle LibreLink in base all'utilizzo del dispositivo all'attivazione. Un sensore attivato con il lettore FreeStyle Libre 2 può essere collegato anche con l'app. I dati non vengono sincronizzati tra i dispositivi.



App FreeStyle LibreLink



Lettore FreeStyle Libre 2



Dati del glucosio digitali: facili da condividere, facili da analizzare

FreeStyle **Libre 2** PLUS



Caricamento
automatico nel cloud




Il sensore circolare FreeStyle Libre 2 Plus trasmette automaticamente i valori del glucosio precisi al minuto³ direttamente allo smartphone¹ o, con una scansione, al lettore².

L'app¹ FreeStyle LibreLink carica automaticamente i dati del glucosio nel cloud.
Nota: i dati del lettore possono essere trasferiti manualmente tramite cavo in LibreView¹⁴⁻¹⁶.



LibreView

Nel **sistema gratuito di gestione dei dati LibreView**, basato sul web, sono disponibili i dati completi del glucosio, rappresentati in report ed analisi comprensibili. I dati possono essere condivisi¹⁶ in tempo reale con lo studio medico curante, a condizione che sia stato creato un account.

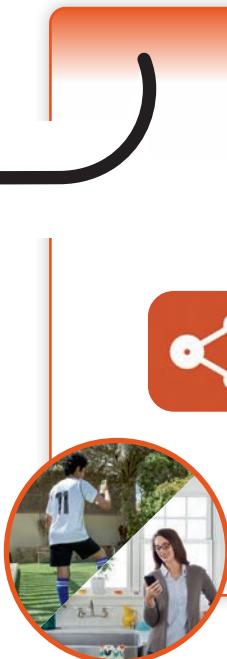

LibreLinkUp

Con l'app gratuita **LibreLinkUp**¹⁶⁻¹⁹ le persone invitate (ad es. i familiari) possono visualizzare¹⁶ i valori del glucosio attuali e l'andamento del glucosio delle ultime 12 ore. Inoltre possono ricevere gli allarmi¹² del glucosio in tempo reale.

Il lettore FreeStyle Libre 2

Visualizzazione sul lettore²

Il lettore può essere utilizzato in parallelo all'app¹ oppure da solo.
Osservare anche le pagine 52–53.



Nota: per ulteriori informazioni riguardanti il lettore e le sue singole funzioni consultare il relativo manuale d'uso.

Avviare il sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il lettore



Premere il **pulsante d'avvio** per accendere il lettore. **Nota:** se si utilizza il lettore per la prima volta, seguire le istruzioni per impostare la data e l'ora.

Toccare «**Avvia un nuovo sensore**». Per ricevere i valori del glucosio avviare il sensore (precedentemente applicato sul lato posteriore della parte superiore del braccio) con una **scansione iniziale**.

A tale scopo tenere il lettore ad una distanza massima di **4 cm** dal sensore.

Per collegare il sensore con il lettore, procedere come segue: il lettore indica che la scansione è riuscita; il sensore è avviato. Dopo **60 minuti** si possono leggere i primi valori del glucosio con una scansione.

Lettura dei valori del glucosio



Premere il **pulsante d'avvio** per accendere il lettore.

A tale scopo tenere il lettore ad una distanza massima di **4 cm** dal sensore.

Il lettore visualizza il valore del glucosio. Ciò include il valore attuale, la freccia della tendenza e l'andamento.



Funzioni di allarme

L'allarme «**Perdita di segnale**^{12,13»} La informa quando:

- manca la connessione tra il sensore e il lettore per più di 20 minuti oppure
- il lettore² dista dal sensore più di 6 metri¹¹.



Per un profilo glicemico completo, scansionare una volta il sensore FreeStyle Libre 2 Plus quando si verifica una perdita di segnale.

Eventuali dati mancanti possono essere recuperati con una scansione al massimo per il periodo delle ultime 8 ore.



Nota: il lettore può ricevere gli allarmi¹² del glucosio da una distanza massima di 6 metri. I valori del glucosio e gli allarmi vengono trasmessi solo al dispositivo collegato per primo. Se si desidera utilizzare gli allarmi, seguire le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Scegliere il dispositivo primario su cui si desidera visualizzare i valori del glucosio e gli allarmi


Avvio del sensore FreeStyle Libre 2 Plus con l'app¹ FreeStyle LibreLink

- ✓ I valori del glucosio e gli allarmi¹² arrivano **direttamente**³ sullo smartphone¹.
- ✓ Trasmissione **automatica** dei dati a LibreView¹⁴⁻¹⁶ e LibreLinkUp¹⁶⁻¹⁹.

FreeStyle LibreLink:

Possibilità di visualizzare gli **allarmi e i valori del glucosio** direttamente e automaticamente sull'app, nonché di leggere i valori del glucosio in qualsiasi momento con una scansione*.

Non si può utilizzare anche il **lettore**².

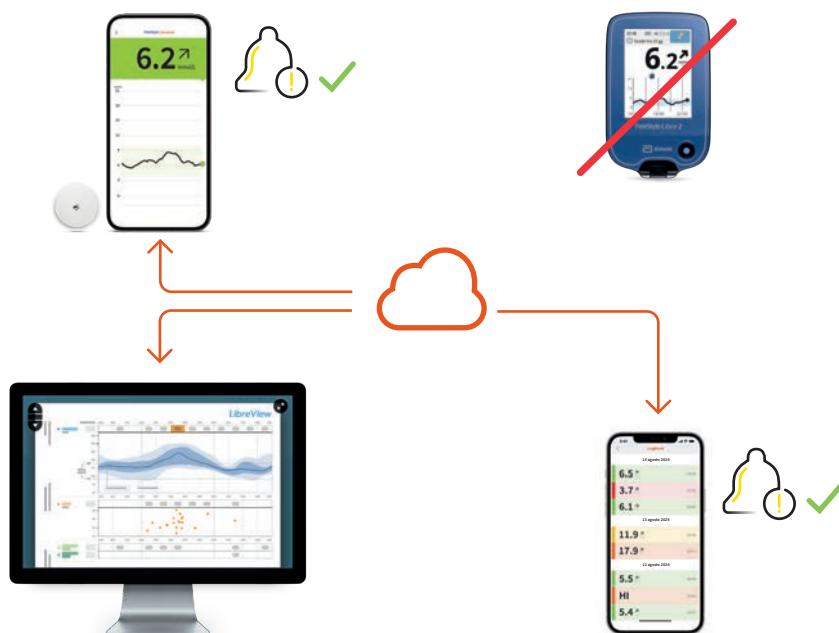

LibreView:

Trasmissione **automatica** di tutti i dati del glucosio e creazione di report (a condizione che sia stato creato un account utente).

LibreLinkUp:

Trasmissione **automatica** di valori del glucosio e allarmi regolabili **individualmente** (a condizione che sia stata stabilita una connessione).

* Il sensore misura il glucosio ogni minuto e salva i dati del glucosio per 8 ore. Per garantire uno storico dei dati senza lacune, il sensore deve essere continuamente collegato allo smartphone tramite Bluetooth o deve essere scansionato almeno ogni 8 ore. È sempre possibile leggere il valore attuale del glucosio con una scansione, ad esempio anche nel caso in cui si verifichi un'interruzione della connessione Bluetooth.

Avvio del sensore FreeStyle Libre 2 Plus con il lettore

- Ricevimento dei dati del glucosio con una **scansione** sul lettore e in via opzionale anche sullo smartphone. Gli allarmi vengono ricevuti solo sul lettore.
- Trasferimento **manuale** dei dati dal lettore a LibreView oppure direttamente dall'app FreeStyle LibreLink (se collegata in aggiunta) a LibreView e LibreLinkUp.

Lettore FreeStyle Libre 2:

Ricevere gli allarmi e leggere i valori del glucosio con una scansione**.

FreeStyle LibreLink (opzionale, utile per una condivisione dei dati diretta con LibreView e LibreLinkUp):
Leggere i valori del glucosio con una scansione**.
Allarmi non disponibili.



LibreView:

Trasmissione dei valori del glucosio disponibili (dopo una scansione) e creazione di report (a condizione che sia stato creato un account utente). In caso di utilizzo parallelo dell'app e del lettore, i valori del glucosio vengono raccolti automaticamente in LibreView.

LibreLinkUp:

Se è stato creato un collegamento dall'app FreeStyle LibreLink: **trasmissione dei valori del glucosio disponibili (dopo una scansione); nessun allarme disponibile.**

** Il sensore misura il glucosio ogni minuto e salva i dati del glucosio per 8 ore. Per garantire uno storico dei dati senza lacune, il sensore deve essere scansionato almeno ogni 8 ore. Gli allarmi vengono trasmessi solo al dispositivo collegato per primo (in questo caso il lettore).



L'ecosistema FreeStyle Libre 2: dati del glucosio digitali facili da condividere, facili da analizzare



Nel sistema gratuito di gestione dei dati LibreView¹⁴⁻¹⁶, basato sul web, sono disponibili i dati completi del glucosio, rappresentati in report ed analisi comprensibili. I dati possono essere condivisi¹⁶ in tempo reale con lo studio medico curante, a condizione che sia stato creato un account.

Con l'app gratuita LibreLinkUp¹⁶⁻¹⁹, le persone invitate (ad es. i familiari) possono visualizzare¹⁶ i valori del glucosio attuali e l'andamento del glucosio delle ultime 12 ore. Inoltre possono ricevere gli allarmi¹² del glucosio in tempo reale.

Panoramica ancora più completa del Suo diabete con LibreView



Analisi online dei dati del glucosio con LibreView¹⁴⁻¹⁶


Il sistema di gestione del diabete sicuro¹⁵ e basato sul web presenta tutti i valori del glucosio **in report e analisi facilmente comprensibili**. Inoltre Lei può condividere¹⁶ i valori misurati direttamente con i Suoi medici e il Suo team di diabetologia, per consentire loro di accedere a **utili informazioni sulla panoramica completa dei Suoi dati del glucosio**.

Potenzialità di LibreView:

- ✓ La condivisione dei report con lo studio medico curante è ancora più semplice grazie al **collegamento^{1,16} diretto dall'app FreeStyle LibreLink con il Suo studio medico**.
- ✓ Una volta stabilito il collegamento, i Suoi valori del glucosio vengono condivisi **automaticamente** con l'account LibreView del Suo **studio medico**. La condivisione dei dati può essere revocata in qualsiasi momento.
- ✓ **Report** facilmente comprensibili e utili **analisi** dei valori misurati aiutano a capire meglio il Suo diabete.
- ✓ Maggiore supporto per i Suoi medici e il Suo team di diabetologia per **decisioni terapeutiche ancora più mirate**.



Con l'ausilio dei report di LibreView, i Suoi medici e il Suo team di diabetologia possono adottare decisioni terapeutiche ancora più mirate.

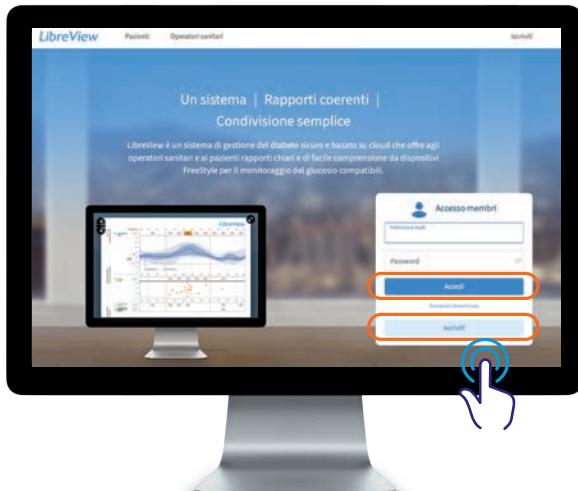

Registrazione gratuita su www.LibreView.com

Tre semplici passi per accedere ai report del glucosio

- 1** Inserire **www.LibreView.com** nel proprio browser web.
- 2** Inserire i **dati di login** dell'app FreeStyle LibreLink.
Se non è stato creato un account nell'app e se non si possiede ancora un account in LibreView, effettuare la registrazione ex novo.
Nota: il login per LibreView e per l'app FreeStyle LibreLink è identico.
- 3** Fare clic su  e poi su  Report del glucosio per **visualizzare i report del glucosio**.



Condivida i dati del glucosio con il Suo team di diabetologia in LibreView. Alla prossima visita potrete valutare insieme i Suoi report. L'individuazione di andamenti e tendenze può contribuire a ottimizzare la Sua terapia.

**Soluzioni digitali per una terapia
più soddisfacente²⁷ e una maggiore
sicurezza^{5,6} nella quotidianità.**




Profilo di glucosio ambulatoriale (AGP) – la routine quotidiana a colpo d'occhio

Con l'AGP i valori del glucosio misurati in più giorni vengono rappresentati in un giorno standardizzato di 24 ore.

Ciò consente di vedere chiaramente:

- se i valori del glucosio sono sempre troppo alti o troppo bassi in determinati momenti.
- se e quanto i valori del glucosio fluttuano.
- se e per quanto tempo i valori del glucosio rimangono nel range target durante il giorno. Può definire il range target insieme al Suo team di diabetologia.


La valutazione regolare dei dati misurati con FreeStyle Libre 2 e l'AGP Le consentono una migliore gestione dei valori del glucosio.

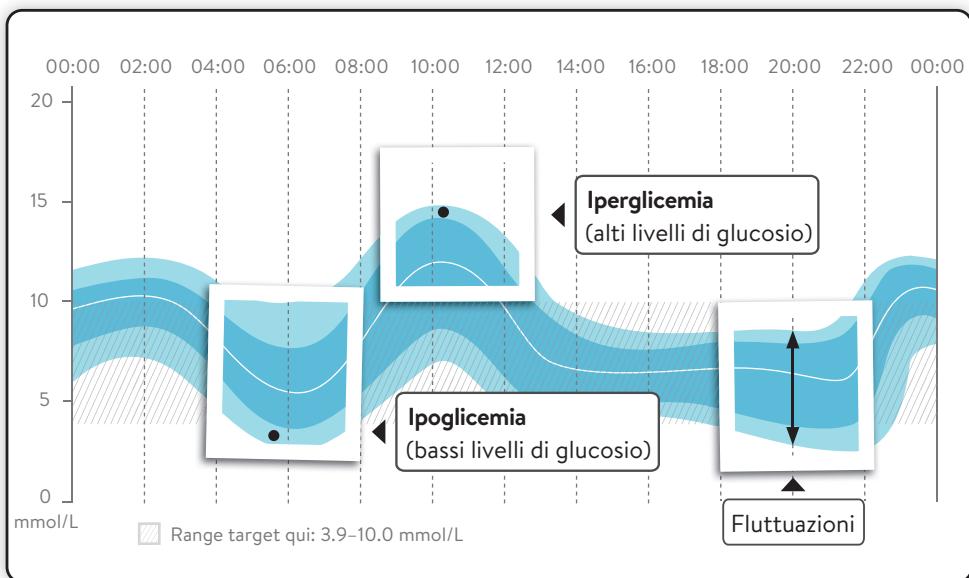

Può visualizzare l'AGP nell'app¹ FreeStyle LibreLink nel report «**Andamento giornaliero**» e in LibreView¹⁴⁻¹⁶. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.LibreView.com.

Il profilo di glucosio ambulatoriale (AGP) in LibreView¹⁴⁻¹⁶ – panoramica

Il report AGP è un report **standardizzato** sviluppato dall'International Diabetes Center (IDC). I dati e i grafici sono rappresentati in modo chiaro e sintetico in un'unica pagina.

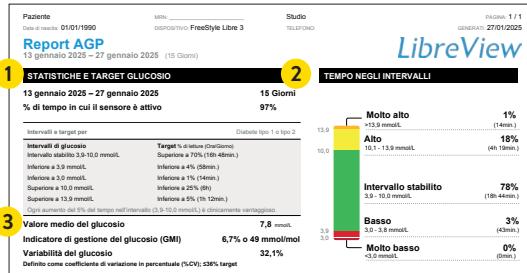

Time above Range (TAR):

tempo al di sopra del range target, area gialla e arancione:
iperglycemia

Time in Range (TIR):

tempo nel range target, area verde.

Time below Range (TBR):

tempo al di sotto del range target, area rossa e rossa scura:
ipoglicemia

1 Statistica dei valori del glucosio e valori target

I dati statistici comprendono il valore medio del glucosio, i range e i valori target del glucosio consigliati, la variabilità e il GMI (indicatore di gestione del glucosio), calcolati per il periodo del report.

2 Tempo nei range

Tempo in percentuale durante il quale i valori del glucosio restano all'interno o all'esterno del range target nel periodo del report. I range target e il valore soglia massimo e minimo del glucosio per il report in esame non possono essere modificati e sono predefiniti in base allo standard raccomandato per il diabete di tipo 1 o tipo 2 (3.9–10.0 mmol/L).²⁶


3 Indicatore di gestione del glucosio (GMI)

Il GMI indica quale sarebbe verosimilmente il valore di laboratorio dell'HbA1c. Per la stima viene impiegato il valore medio del glucosio tratto dai dati misurati dal sensore nel periodo del report.

Nota: il GMI è diverso dal valore dell'HbA1c, che viene calcolato in laboratorio da un campione di sangue.


4 PROFILO DI GLUCOSIO AMBULATORIALE (AGP)

AGP è un riassunto dei valori di glucosio del periodo di riferimento, con la mediana (50%) e gli altri percentili mostrati come se si fossero verificati in un solo giorno.

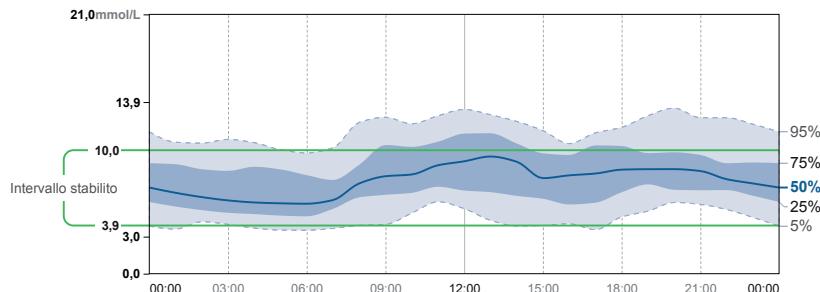

5 PROFILI GIORNALIERI DI GLUCOSIO

Ogni profilo giornaliero rappresenta un periodo da mezzanotte a mezzanotte con la data visualizzata nell'angolo in alto a sinistra.

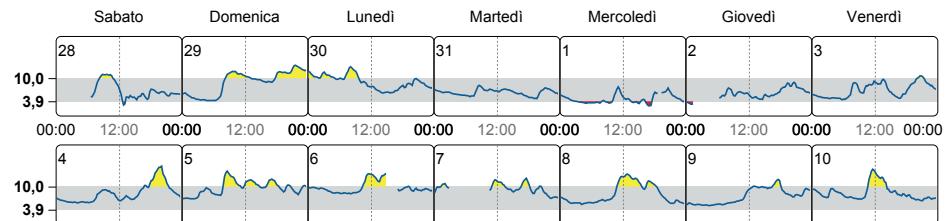

4 Profilo di glucosio ambulatoriale (AGP)

Si tratta di una rappresentazione grafica del 5°, 25°, 50° (mediana), 75° e 95° percentile dei valori del glucosio misurati per il periodo del report.

5 Profili del glucosio giornalieri

Questi profili giornalieri singoli vengono generati per i dati raccolti al massimo negli ultimi 14 giorni.




Il monitoraggio continuo del glucosio può aiutarLa a migliorare il controllo del diabete fornendo un quadro dettagliato dei valori, delle tendenze e dell'andamento del glucosio. L'AGP è utile per capire meglio l'andamento del glucosio e per migliorarne la gestione.

Per scoprire come condividere^{16,18} facilmente i report con il Suo studio medico può consultare le pagine seguenti.



Condividere i dati del glucosio con il team di diabetologia

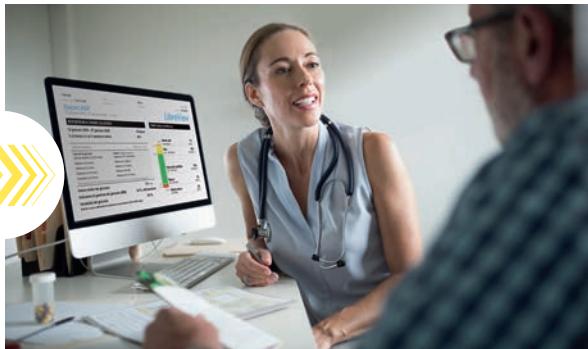

Si colleghi al Suo team di diabetologia tramite l'app¹ FreeStyle LibreLink.

Questa funzione integrata nell'app FreeStyle LibreLink Le consente di condividere molto facilmente i valori del glucosio con il team di diabetologia curante tramite LibreView¹⁴⁻¹⁶.



Può ricevere preziose informazioni sui Suoi valori del glucosio e sulle relative tendenze.

I Suoi valori del glucosio vengono caricati automaticamente in LibreView. LibreView è un sistema di gestione del diabete basato sul web, che fornisce sia a Lei che al Suo team di diabetologia l'accesso a report comprensibili e a preziose analisi dei valori misurati.

I vantaggi di FreeStyle LibreLink e LibreView:



FACILE COLLEGAMENTO

Si colleghi facilmente al Suo team di diabetologia curante tramite l'app FreeStyle LibreLink.



CONDIVISIONE¹⁶ AUTOMATICA DEI DATI

Una volta stabilito il collegamento, i valori del glucosio vengono condivisi automaticamente con l'account LibreView del Suo team di diabetologia.




VISITE MEDICHE PIÙ EFFICACI

Il Suo team di diabetologia riceve preziose informazioni sui Suoi valori misurati, che lo aiutano a prendere decisioni terapeutiche fondate.

Opzione 1: avvio della condivisione dei dati del glucosio con l'app


Chiedere al team di diabetologia l'ID³⁶ LibreView¹⁴⁻¹⁶ dello studio e annotarlo sull'ultima pagina. Inserire l'ID dello studio nell'app¹ FreeStyle LibreLink.

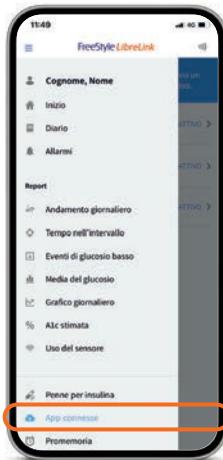

- 1 Toccare «Menu» e andare su «App connesse».



- 2 In LibreView selezionare «Connetti».

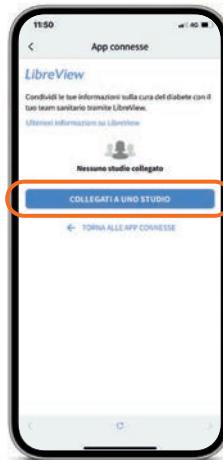

- 3 Toccare «Collegati a uno studio».



- 4 Inserire l'ID dello studio, quindi toccare «Avanti».




- 5 Verificare i dati di contatto e selezionare «Connetti».



- 6 Fatto! La connessione con il team di diabetologia è stata stabilita.

Opzione 2: invito del team di diabetologia a condividere i dati del glucosio


Il team di diabetologia può inviarLe un invito a condivider¹⁶ i Suoi dati del glucosio. L'invito può essere accettato direttamente nell'app o nell'e-mail di invito.

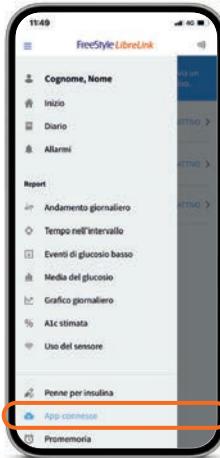

1 Toccare «Menu» e andare su «App connesse».




2 In LibreView selezionare «Connetti».

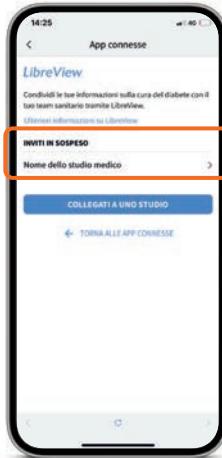

3 Toccare l'invito interessato sotto «Inviti in sospeso».




4 Verificare i dati di contatto e toccare «Accetta» per accettare l'invito.

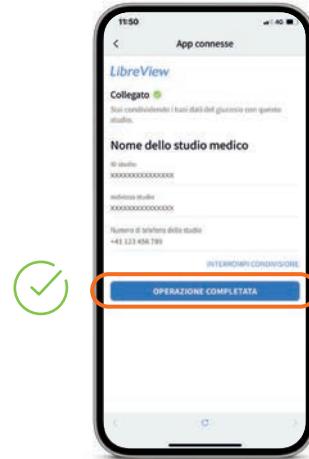

5 **Fatto!** La connessione con il team di diabetologia è stata stabilita.

Condividere i dati del glucosio con familiari e amici

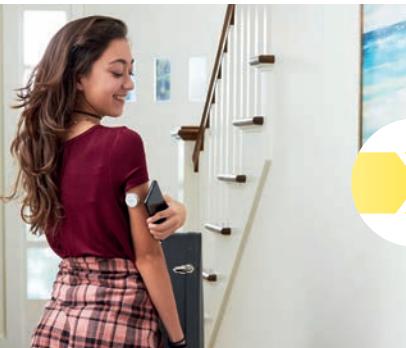

FreeStyle **Libre 2** PLUS

Con l'app¹ FreeStyle LibreLink può stabilire un collegamento diretto all'app¹⁶⁻¹⁹ LibreLinkUp e far sapere ai Suoi familiari e amici che sta bene^{19,37}.

Condividere i valori e gli allarmi¹² del glucosio con persone di fiducia per una maggiore sicurezza¹⁹ nella vita quotidiana.

LibreLinkUp

Con l'app LibreLinkUp può far sì che i Suoi valori del glucosio siano visualizzati sullo smartphone di familiari e amici.


Persone da Lei scelte vengono informate dei Suoi valori del glucosio indipendentemente da dove si trova^{19,37}.

Potenzialità di LibreLinkUp:

- ✓ Può condividere i Suoi dati del glucosio con un massimo di 20 persone.
- ✓ Ogni valore del glucosio registrato nell'app FreeStyle LibreLink e gli allarmi* impostati vengono trasmessi automaticamente.
- ✓ In questo modo i valori e le tendenze del glucosio possono essere controllati anche da remoto e i valori misurati e gli allarmi* impostati possono essere monitorati sia di giorno che di notte^{5,6}.
- ✓ Familiari e amici scelti da Lei possono aiutarLa a gestire ancora meglio il diabete.

* Gli allarmi vengono trasmessi se il sensore è stato avviato con l'app.

La condivisione dei Suoi valori del glucosio con l'app LibreLinkUp è ancora più semplice.

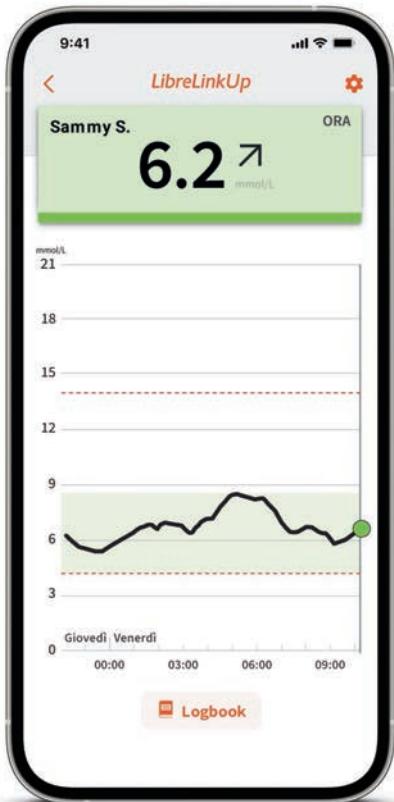

Con l'app gratuita LibreLinkUp, selezionando la voce «**App connesse**» nel menu principale della Sua app¹ FreeStyle LibreLink, può invitare fino a **20 persone** a seguire i Suoi valori attuali del glucosio, la freccia della tendenza, l'andamento del glucosio e gli allarmi¹² impostati.

Le persone invitate riceveranno un'e-mail contenente le istruzioni di installazione dell'app LibreLinkUp.

Scarichi ora gratuitamente
l'app **FreeStyle LibreLinkUp!**



PER UNA MAGGIORE SICUREZZA NELLA VITA QUOTIDIANA

I dati del glucosio possono essere condivisi facilmente con un massimo di **20 persone**.

Informazioni per l'acquisto dei prodotti FreeStyle Libre

Dove posso acquistare i prodotti FreeStyle Libre 2?

I prodotti FreeStyle Libre 2 possono essere acquistati in molti luoghi: ad esempio dal proprio medico, in ospedale, in numerose farmacie, presso l'associazione per il diabete oppure con estrema semplicità e comodità da noi, **online**, sul sito www.FreeStyle.Abbott. Tenere presente che i prezzi possono variare a seconda della fonte d'acquisto.

Vantaggi dell'acquisto dei prodotti FreeStyle Libre 2 sul sito www.FreeStyle.Abbott:

- Nessuna quantità minima d'ordine
- Nessuna spesa di spedizione
- Possibilità di ordinare 24 ore su 24
- Consegnna diretta a domicilio
- Account personale con panoramica di ordini e fatture

Chi può utilizzare il sistema di misurazione FreeStyle Libre 2?

Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus è indicato per l'uso con un dispositivo compatibile per misurare la concentrazione del glucosio nel fluido interstiziale delle persone con diabete mellito dai 2 anni in su, comprese le donne in gravidanza. Il sensore e il dispositivo compatibile sostituiscono la misurazione della glicemia nell'autogestione del diabete.

FreeStyle Libre – il sistema di misurazione
del glucosio più utilizzato al mondo²¹



Potrà trovare ulteriori informazioni sui nostri prodotti FreeStyle Libre, risposte a domande frequenti, informazioni sull'acquisto e sul rimborso, nonché molte altre indicazioni utili sul nostro sito web: www.FreeStyle.Abbott.



Informazioni sull'assunzione dei costi da parte della cassa malati

La mia cassa malati mi rimborsa i costi per i prodotti FreeStyle Libre 2?

Per ottenere il rimborso dalla cassa malati è necessaria una prescrizione. Nella sezione successiva sono specificati i requisiti per ricevere il rimborso e le possibilità per ottenere questa prescrizione. In ogni caso, prima di utilizzare FreeStyle Libre 2 consulti il Suo medico.

Requisiti per l'assunzione dei costi:

Per l'assunzione dei costi dei sensori e dei lettori dei sistemi FreeStyle Libre 2 da parte della cassa malati è necessaria una prescrizione ai sensi dell'EMAp (Elenco dei mezzi e degli apparecchi dell'Ufficio federale della sanità pubblica)⁴³.

Nota: Si rivolga al Suo medico o alla Sua farmacia.

Come ottengo il rimborso dei costi dalla mia cassa malati?

Se all'acquisto provvede Lei stesso al pagamento dei prodotti FreeStyle Libre 2, riceverà una fattura e/o una ricevuta. Invii questo documento alla Sua cassa malati unitamente alla prescrizione attualmente valida (sistema del terzo garante). La cassa malati controlla i documenti inviati e rimborsa l'importo eventualmente spettante.*

Nota:

La invitiamo a notare che solo la Sua cassa malati ha il quadro completo del **limite massimo di acquisto** di prodotti che può fare. La cassa malati **somma** i Suoi acquisti, indipendentemente da dove ha comperato i prodotti (online, medico, ospedale, farmacia, associazione per il diabete). La invitiamo pertanto a consultare la Sua cassa malati per conoscere i Suoi limiti di acquisto per l'anno solare in corso. Al raggiungimento di questo limite, pagherà autonomamente gli eventuali acquisti aggiuntivi di prodotti.



* Per gli importi massimi rimborsabili attualmente in vigore consultare l'EMAp all'indirizzo www.bag.admin.ch/it/elenco-dei-mezzi-e-degli-apparecchi-emap

Servizio clienti

Ha domande? Il nostro servizio clienti sarà lieto di aiutarLa!

Per domande generiche sul sistema FreeStyle Libre o sugli ordini online:



0800 804 404* (numero verde)

- Richieste relative ai prodotti FreeStyle Libre
- Supporto per gli ordini online
- Prezzi e rimborso

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00 e il sabato (lavorativo) dalle ore 09:00 alle 17:00.

Per domande sulle nostre applicazioni digitali (app^{1,15} e LibreView¹⁴⁻¹⁶):



0800 102 102* (numero verde)

- App¹ FreeStyle LibreLink
- LibreLinkUp¹⁶⁻¹⁹
- LibreView

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00.

Siamo a Sua disposizione nelle lingue: tedesco francese italiano

* Le chiamate al servizio clienti potrebbero essere registrate e memorizzate da Abbott su server situati nella UE. Utilizzando i numeri 0800 804 404 e 0800 102 102 l'utente dichiara di acconsentire a questa procedura. Servizio gratuito dalla rete fissa e dalla rete mobile svizzera a livello nazionale.

Reclami su prodotti

In caso di reclami su prodotti tenere sempre sotto mano quanto segue:

- il numero di serie del sensore FreeStyle Libre 2 Plus interessato
- il proprio sensore FreeStyle Libre 2 Plus e il proprio smartphone o lettore

Dove si trova il numero di serie?

- nell'app FreeStyle LibreLink o nel lettore
- sul lato esterno del sensore FreeStyle Libre 2 Plus
- sulla confezione del sensore



Come procedere: innanzitutto contattare il servizio clienti e solo successivamente smaltire oppure rispedire il sensore. Per domande di natura medica rivolgersi al medico curante.



Appunti personali

I miei dati più importanti

Scarichi gratuitamente l'app¹ FreeStyle LibreLink



I miei dati di login per l'app FreeStyle LibreLink e per LibreView¹⁴⁻¹⁶

Nota: il login per l'app FreeStyle LibreLink e per LibreView è identico.
Annoti qui l'indirizzo e-mail e la password che ha utilizzato.

Indirizzo e-mail: _____

Password: _____

ID³⁶ del mio studio

Riceve l'ID dello studio dal Suo team di diabetologia.

ID dello studio: _____




Registrazione gratuita su www.LibreView.com

Il mio range target del glucosio

Annoti qui il Suo personale range target del glucosio dopo averlo definito insieme al Suo team di diabetologia:

Nota: il Suo range target del glucosio non corrisponde ai Suoi valori limite di allarme.

Il mio range target del glucosio: _____

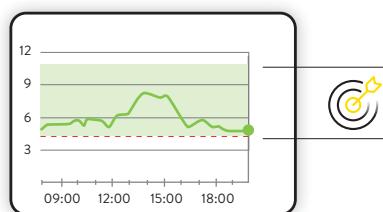


I miei valori limite di allarme

Annoti qui i Suoi personali valori limite di allarme dopo averli definiti insieme al Suo team di diabetologia:

In caso di glucosio alto: _____

In caso di glucosio basso: _____

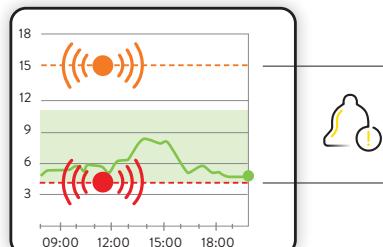





Le immagini sono foto di agenzia scattate con modelli. I dati del glucosio hanno scopo illustrativo e non sono dati reali di pazienti.

© 2025 Abbott. Tutti i diritti riservati. Libre, il logo con la farfalla, la forma e l'aspetto del sensore, il colore giallo e tutti i marchi e/o design a essi associati sono proprietà intellettuale del gruppo di aziende Abbott in Paesi selezionati. Apple e il logo Apple sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google LLC. NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus sono marchi registrati di Novo Nordisk A/S.

I sistemi di misurazione FreeStyle Libre sono certificati per bambini dai 2 anni in su e adulti, comprese le donne incinte. La supervisione dell'uso e la valutazione dei sistemi di misurazione FreeStyle Libre nei bambini fino ai 12 anni sono responsabilità di un adulto.

1. Le app del sistema FreeStyle Libre sono compatibili solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare le app, consultare il sito web www.FreeStyle.Abbott per verificare la compatibilità del dispositivo. 2. L'app FreeStyle LibreLink e il lettore FreeStyle Libre 2 hanno funzioni simili, ma non identiche. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus comunica con il lettore FreeStyle Libre 2 e/o con l'app FreeStyle LibreLink in base all'utilizzo del dispositivo all'attivazione. Un sensore attivato con il lettore FreeStyle Libre 2 può essere collegato anche con l'app. I dati non vengono sincronizzati tra i dispositivi. 3. Il sensore è pronto per la misurazione del glucosio 60 minuti dopo l'attivazione. 4. A confronto con altri sensori applicati sul corpo, i dati sono disponibili. Abbott Diabetes Care. 5. Haak, Thomas, et al. Diabetes Therapy. 2017; 8 (1): 55–73. Lo studio è stato condotto su 224 adulti. 6. Bolinder, Jan, et al. The Lancet. 2016; 388 (10057): 2254–2263. Lo studio è stato condotto su 239 adulti. 7. Il sensore è impermeabile all'acqua fino alla profondità di 1 m e fino a 30 minuti. 8. I dati sono disponibili. Abbott Diabetes Care. 9. L'applicazione del sensore richiede l'inserimento del filamento del sensore sotto la cute. Il sensore può essere indossato per un massimo di 15 giorni. 10. L'app FreeStyle LibreLink funziona con i sensori FreeStyle Libre 2 Plus ed è compatibile esclusivamente con NovoPen® 6 e NovoPen Echo® Plus. 11. Elementi fisici come ad es. un muro potrebbero compromettere la connessione dati. Tuttavia, il sensore continua a misurare e salvare i dati del glucosio fino a 15 giorni. 12. Gli allarmi sono disattivati per impostazione predefinita e devono essere attivati. 13. L'allarme di perdita di segnale viene attivato automaticamente non appena si attiva per la prima volta un allarme del glucosio. L'allarme Perdita di segnale può essere disattivato e riattivato in qualunque momento. 14. Il sito web LibreView è compatibile solo con determinati sistemi operativi e browser. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.LibreView.com. 15. LibreView è un'applicazione basata su cloud. I dati LibreView vengono trasmessi su una rete virtuale non pubblica e conservati in una banca dati su server SQL. I dati sono crittografati a livello dei file. La crittografia e il tipo di funzioni dell'archivio chiavi evitano che il provider dell'host nel cloud (Amazon Web Services) possa visualizzare i dati. L'utilizzo di LibreView in Svizzera prevede l'hosting dei dati su server della UE. L'accesso a qualsiasi account utente è protetto da password. 16. Il trasferimento di dati tra le app del sistema FreeStyle Libre richiede una connessione Internet. 17. L'app LibreLinkUp è compatibile solo con determinati dispositivi mobili e sistemi operativi. Prima di utilizzare l'app, consultare il sito web www.LibreLinkUp.com. 18. La condivisione dei dati all'interno delle app del sistema FreeStyle Libre richiede la registrazione a LibreView. 19. È possibile accettare l'invito di LibreLinkUp e ricevere o rifiutare notifiche e avvisi. Si raccomanda di decidere in merito sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze per poter reagire in modo adeguato in caso si ricevano valori del glucosio troppo alti o troppo bassi. 20. Il controllo dei valori del glucosio deve essere ripetuto con un misuratore della glicemia, quando i sintomi non corrispondono alle letture o agli allarmi del sistema. 21. La dichiarazione si basa sul numero di utenti mondiali del sistema FreeStyle Libre rispetto al numero di utenti di altri rinomati sistemi per la misurazione del glucosio basati su sensori per uso personale. I dati sono disponibili. Abbott Diabetes Care Inc. 22. Bailey T et al. Diabetes Technology Ther. 2015;17(11):787–794. 23. La salvietta imbevuta di alcol non è compresa nel set del sensore. 24. Applicare la medicazione o il tape per fissare il sensore, senza coprire il foro di quest'ultimo. 25. Per attivare il sensore, occorre stabilire una connessione con l'app mediante una scansione iniziale. 26. Battelino Tadej, et al., Diabetes Care. 2019;42(8):1593–1603. 27. Yaron Marianna, et al., Diabetes Care. 2019;42(7):1178–1184. 28. Vigersky RA, McMahon C. Diabetes Technol Ther. 2019;21(2):81–85. 29. Beck RW, Bergental RM, Riddleworth TD, et al. Diabetes Care. 2019;42(3):400–405. 30. Per adulti con diabete di tipo 1 e 2 che non sono in gravidanza, anziani o pazienti a rischio. 31. Evans M et al., Diabetes Ther. 2022. <https://doi.org/10.1007/s13300-022-01253-9>. 32. Lang, J., et al. Poster session ATTD19-0299 ATTD Berlin, Germany; 2019. 33. Per ricevere gli allarmi dalle app del sistema FreeStyle Libre sullo smartwatch è necessario avere attivato la funzione di allarme, avere collegato il cellulare con lo smartwatch e avere configurato entrambi i dispositivi alla ricezione di notifiche per rendere disponibili le notifiche. 34. Gli smartwatch compatibili sono quelli che supportano la riproduzione delle notifiche. Consultare il sito web www.FreeStyle.Abbott per avere maggiori informazioni sulla compatibilità degli smartwatch. 35. Per un profilo glicemico completo, si deve sostituire il sensore FreeStyle Libre 2 Plus ogni 15 giorni ed eseguire una scansione quando si verifica una perdita di segnale. 36. L'ID dello studio medico è un codice univoco composto da 8–16 cifre. Questo codice viene creato non appena il medico o una persona dello studio attiva la funzione «Studio medico» dell'account Specialisti di LibreView. Se il medico non conosce l'ID LibreView dello studio, può effettuare l'accesso a Specialisti in LibreView e reperirlo nella sezione dati dello studio medico. 37. L'utilizzo di LibreLinkUp richiede la registrazione a LibreView. 38. Elenco dei mezzi e degli apparecchi dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica.

Numero del servizio clienti per tutte le domande relative al sistema FreeStyle Libre 2



0800 804 404*

(numero verde)

Dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00.
Sabato (lavorativo) dalle ore 09:00 alle 17:00.

* Le chiamate al servizio clienti potrebbero essere registrate e memorizzate da Abbott su server situati nella UE. Utilizzando il numero 0800 804 404 l'utente dichiara di acconsentire a questa procedura. Servizio gratuito dalla rete fissa e dalla rete mobile svizzera a livello nazionale.

Il mio team di diabetologia

1

Cognome:

E-mail:

Tel.:

2

Cognome:

E-mail:

Tel.:

Nota: Tabella di conversione mg/dL – mmol/L disponibile sul retro.


**FreeStyle
Libre 2
PLUS**

© 2025 Abbott. Tutti i diritti riservati. Libre, il logo con la farfalla, la forma e l'aspetto del sensore, il colore giallo e tutti i marchi e/o design a essi associati sono proprietà intellettuale del gruppo di aziende Abbott in Paesi selezionati. | ADC-115966 v2.0

**Ha domande?
Saremo lieti di fornirLe assistenza!**

Numero del servizio clienti per tutte le domande relative al sistema FreeStyle Libre 2:



0800 804 404* (numero verde)

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00 e il sabato (lavorativo) dalle ore 09:00 alle 17:00.

Numero del servizio clienti per le nostre applicazioni digitali (app^{1,15} e LibreView¹⁴⁻¹⁶):



0800 102 102* (numero verde)

Siamo raggiungibili dal lunedì al venerdì (lavorativi) dalle ore 08:00 alle 18:00.

* Le chiamate al servizio clienti potrebbero essere registrate e memorizzate da Abbott su server situati nella UE. Utilizzando i numeri 0800 804 404 e 0800 102 102 l'utente dichiara di acconsentire a questa procedura. Servizio gratuito dalla rete fissa e dalla rete mobile svizzera a livello nazionale.

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo **www.FreeStyle.Abbott**




**FreeStyle
Libre 2
PLUS**

© 2025 Abbott | ADC-115966 v2.0


Abbott